
Proton.icon CDCl3 {C:\Bruker\TopSpin3.2.7} LCM 40

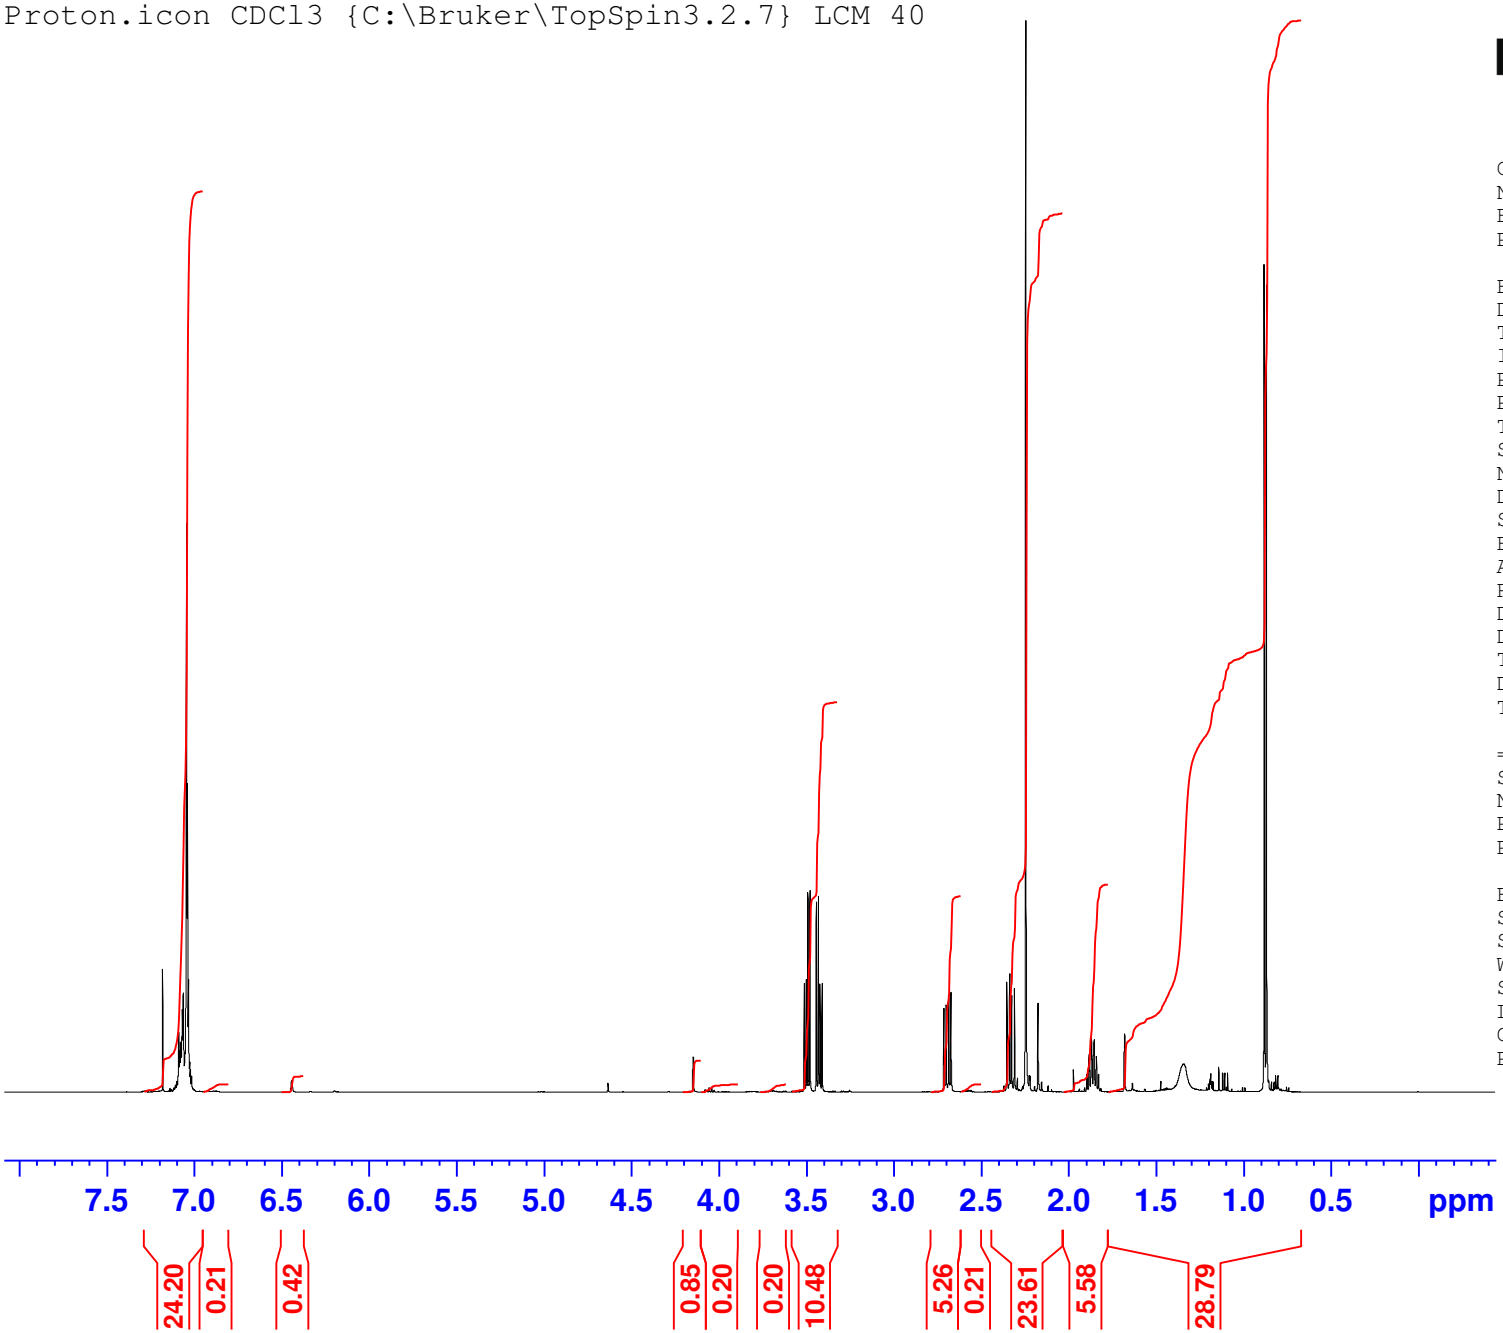


```
Current Data Parameters
NAME         500_AS713H1
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20230612
Time               16.10
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm CPPBBO BB
PULPROG             zg30
TD                131072
SOLVENT             CDCl3
NS                    32
DS                     0
SWH             8000.000 Hz
FIDRES          0.061035 Hz
AQ              8.1920004 sec
RG                 106.9
DW                62.500 usec
DE                41.60 usec
TE                296.1 K
D1             0.10000000 sec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1          500.1735012 MHz
NUC1                  1H
P1                 12.00 usec
PLW1          15.39999962 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF            500.1700513 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 0.10 Hz
GB        0
PC                 1.00
```