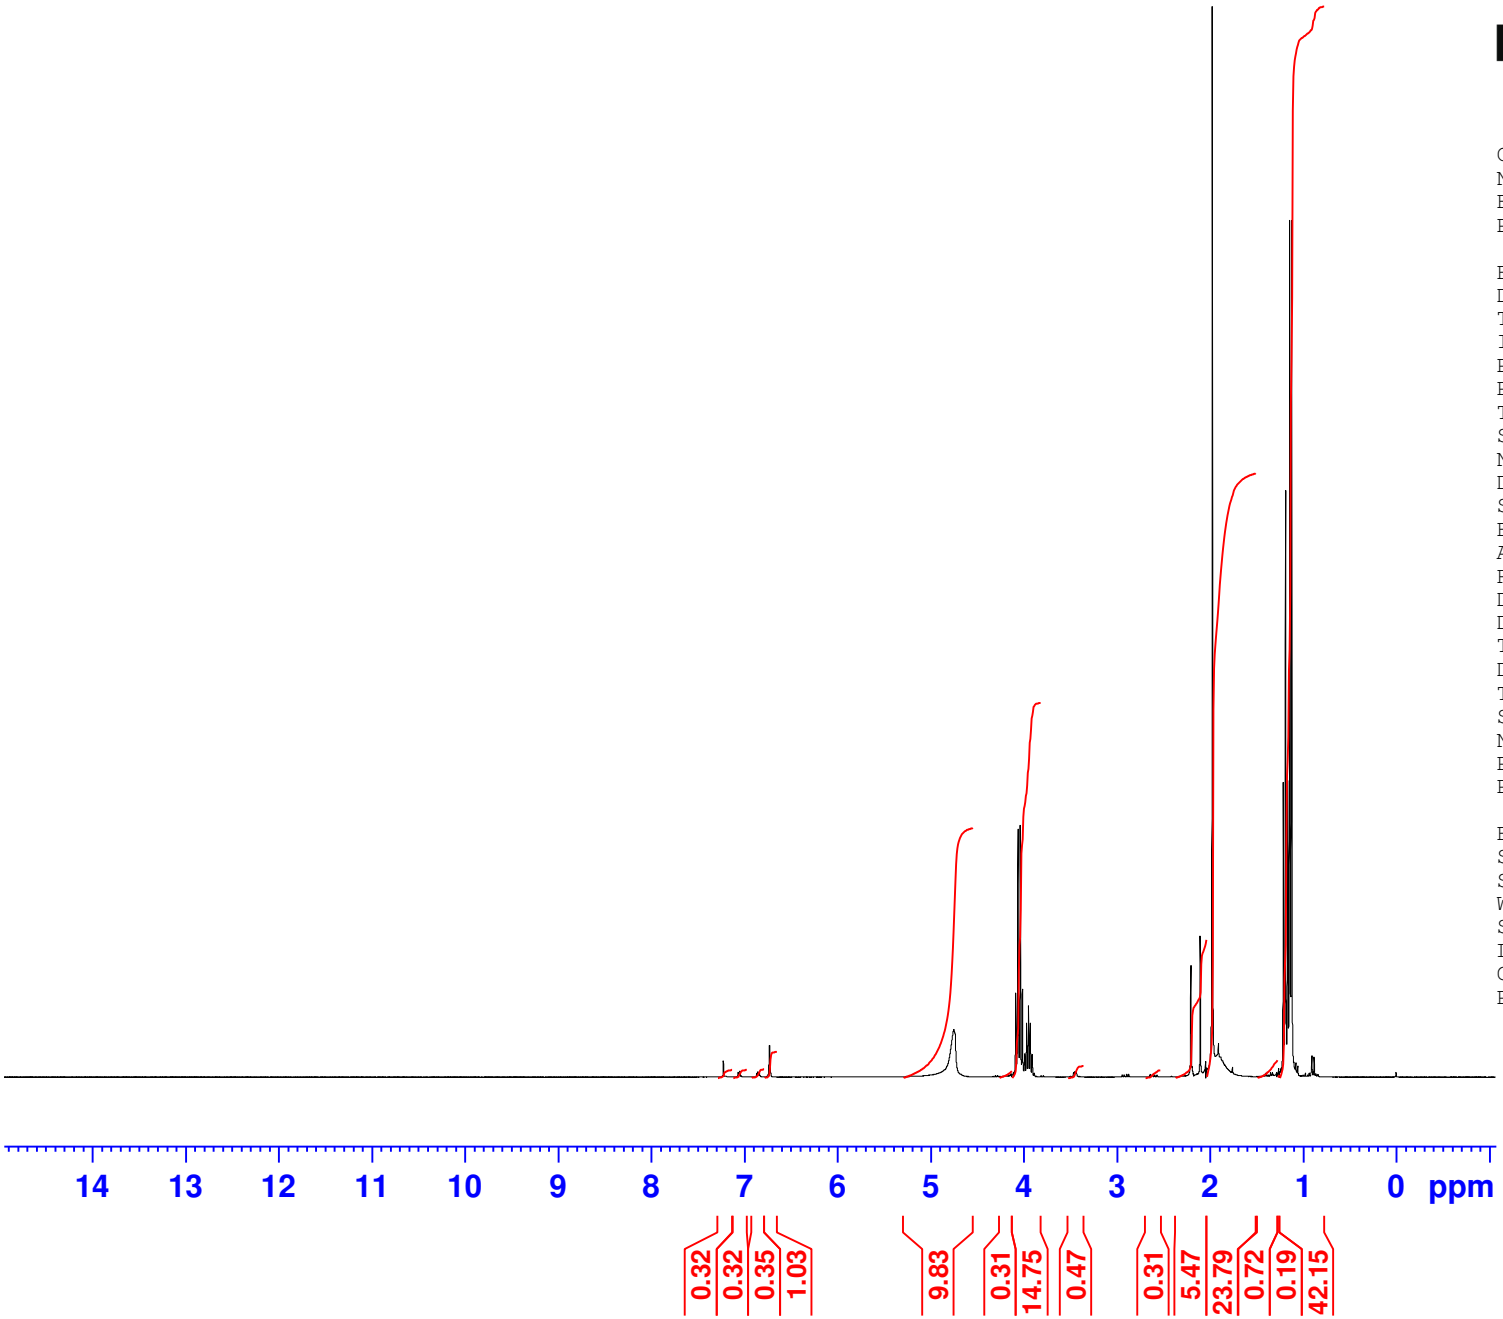


BRUKER

Current Data Parameters
NAME 300_AS732
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20230705
Time 11.32 h
INSTRUM spect
PROBHD Z111650_0118 (
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 0
SWH 4807.692 Hz
FIDRES 0.146719 Hz
AQ 6.8157439 sec
RG 71.14
DW 104.000 usec
DE 8.50 usec
TE 294.4 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 300.1321009 MHz
NUC1 1H
P1 15.00 usec
PLW1 10.00000000 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 300.1300173 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.10 Hz
GB 0
PC 1.00