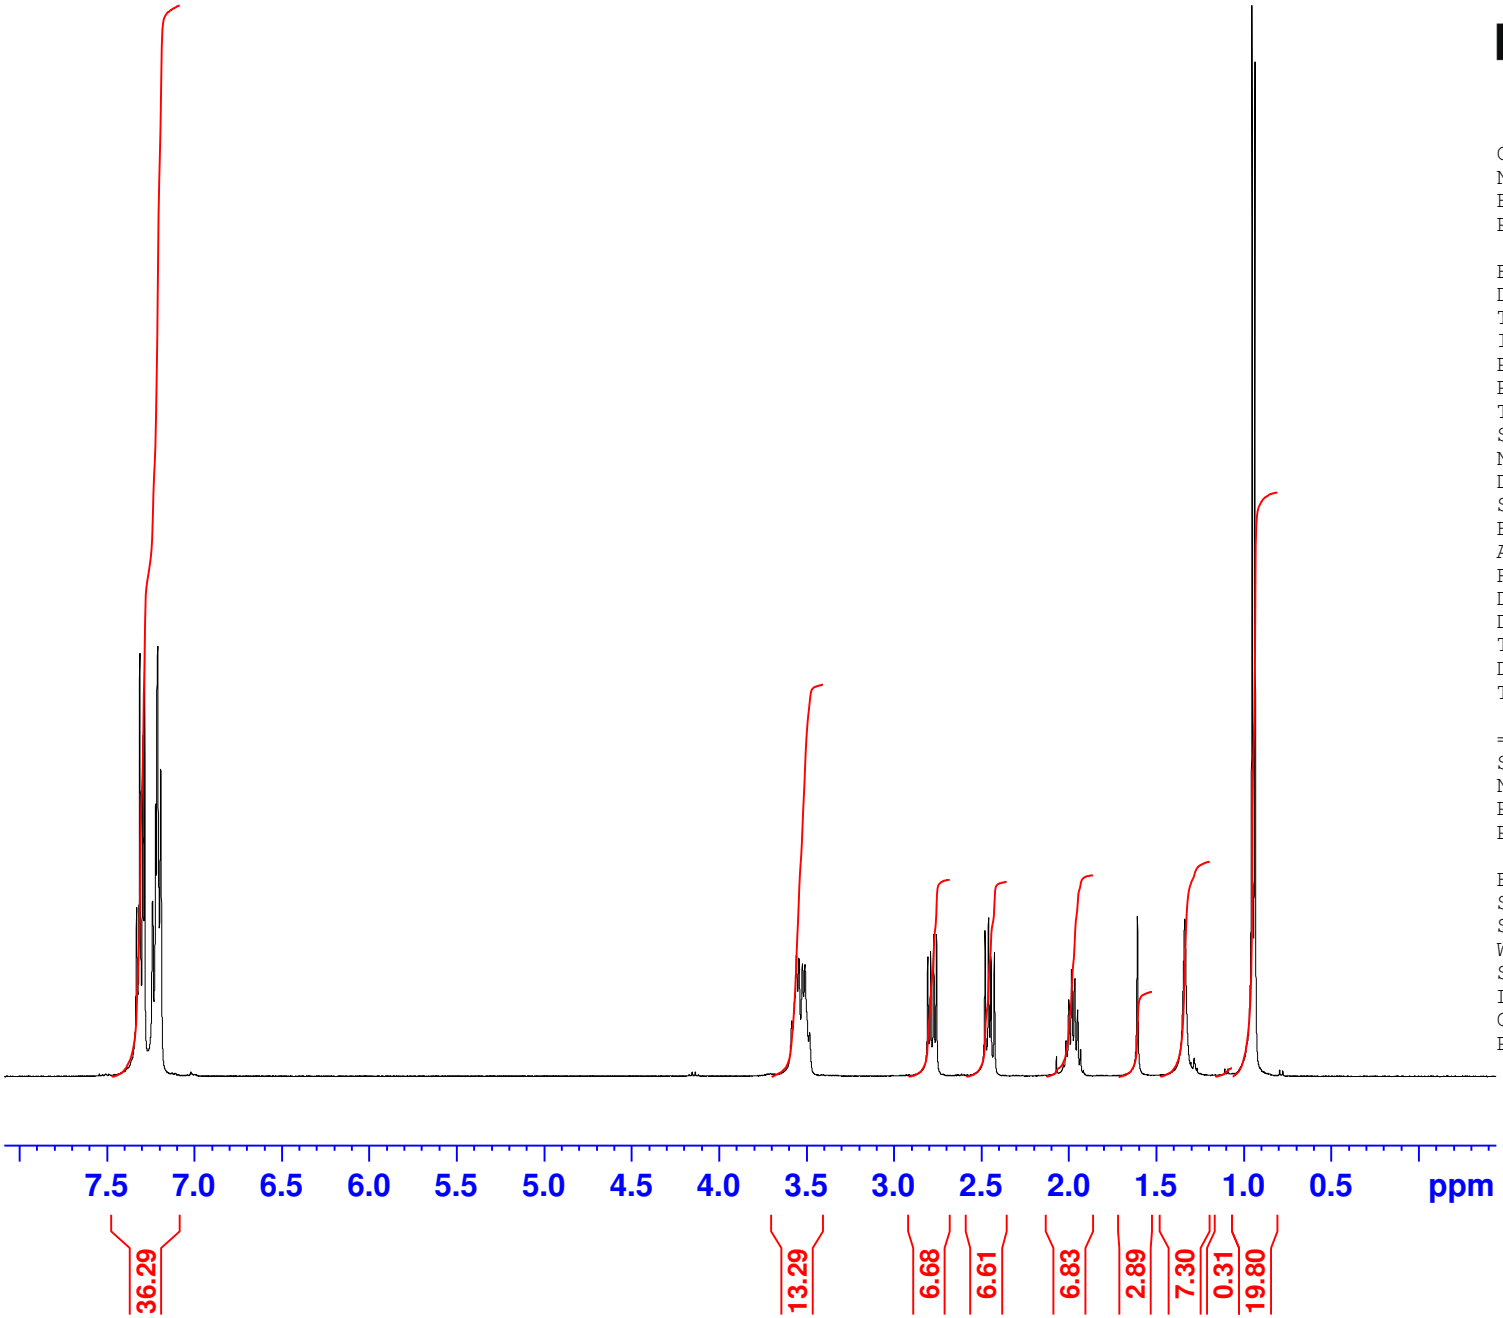


Current Data Parameters
NAME 400_AS801P1pH1
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20251020
Time 14.42
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BB/
PULPROG zg30
TD 131072
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 0
SWH 6402.049 Hz
FIDRES 0.048844 Hz
AQ 10.2367229 sec
RG 93.49
DW 78.100 usec
DE 13.89 usec
TE 292.8 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1 400.1328009 MHz
NUC1 1H
P1 10.00 usec
PLW1 14.30000019 W

F2 - Processing parameters
SI 131072
SF 400.1300000 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.20 Hz
GB 0
PC 1.00