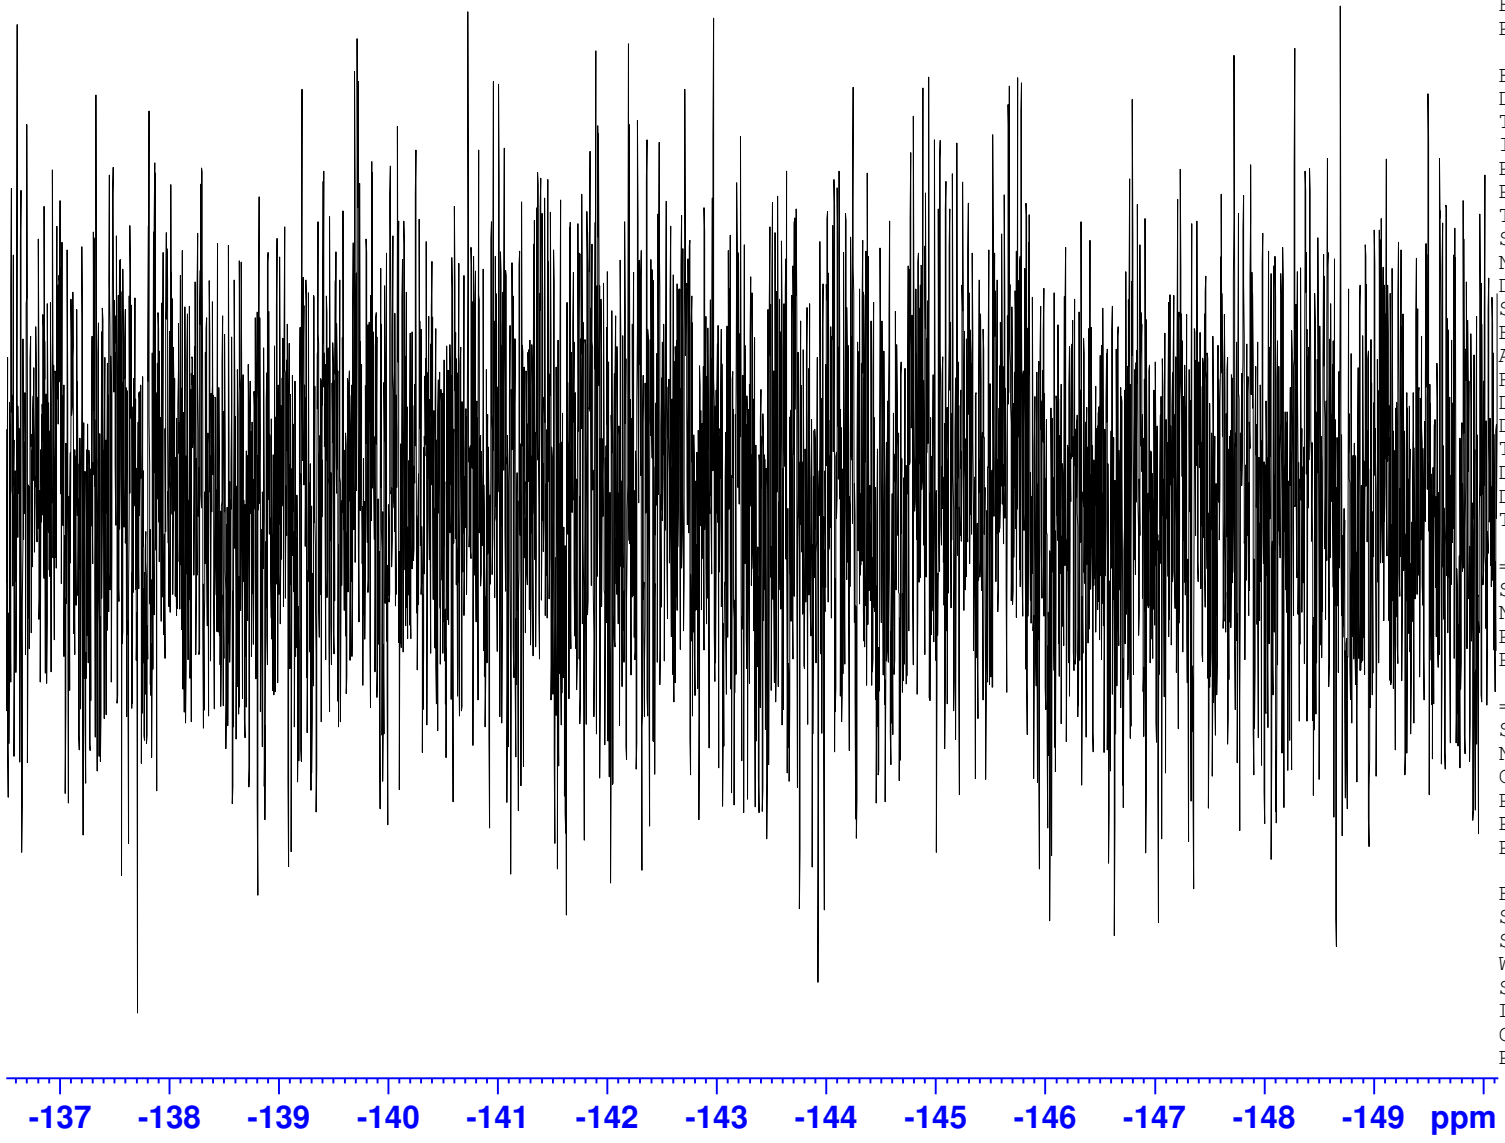


Current Data Parameters
NAME 400_AS860-2st
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20260817
Time 11.28
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BB/
PULPROG zgig30
TD 261896
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 4
SWH 150000.000 Hz
FIDRES 0.572746 Hz
AQ 0.8729867 sec
RG 208.99
DW 3.333 usec
DE 6.60 usec
TE 292.6 K
D1 1.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
TD0 1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1 376.4607150 MHz
NUC1 19F
P1 15.00 usec
PLW1 22.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2 400.1316006 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz16
PCPD2 90.00 usec
PLW2 14.30000019 W
PLW12 0.18729000 W

F2 - Processing parameters
SI 262144
SF 376.4983662 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 2.00