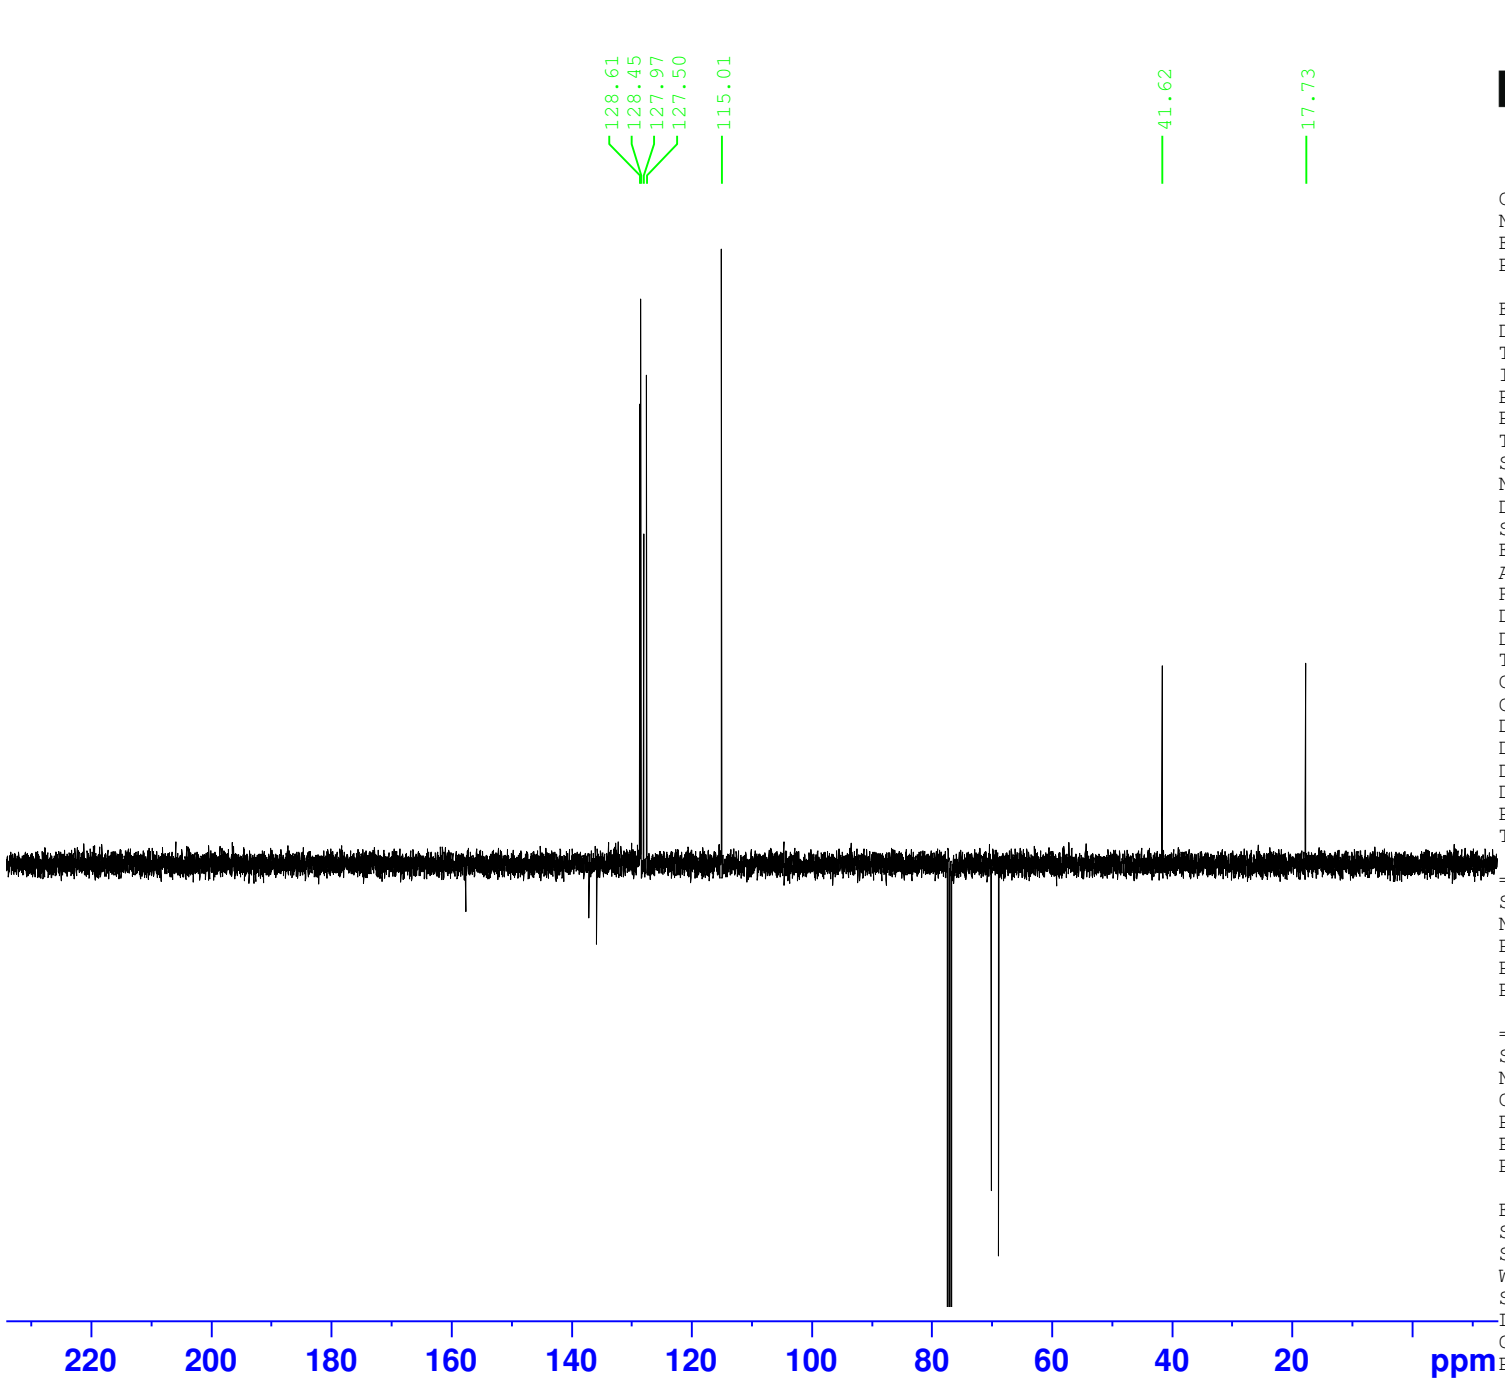



```
Current Data Parameters
NAME      400_AS884P2APT
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20251222
Time               20.55
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG             apt
TD                119044
SOLVENT             CDCl3
NS                    512
DS                      4
SWH            25000.000 Hz
FIDRES             0.210006 Hz
AQ             2.3808801 sec
RG                 208.99
DW                 20.000 usec
DE                  9.73 usec
TE                 293.4 K
CNST2         145.0000000
CNST11          1.0000000
D1             1.00000000 sec
D11            0.03000000 sec
D20            0.00689655 sec
D21            0.00050000 sec
P1                 10.00 usec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1          100.6238346 MHz
NUC1                  13C
P0                 10.00 usec
P2                 20.00 usec
PLW1          59.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2          400.1316005 MHz
NUC2                  1H
CPDPRG[2          waltz64
PCPD2              90.00 usec
PLW2          14.30000019 W
PLW12          0.18729000 W

F2 - Processing parameters
SI                 131072
SF            100.6127685 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 1.00 Hz
GB        0
PC                 1.40
```