
APT CDCl3 {C:\Bruker\TopSpin3.2.7} LCM 17

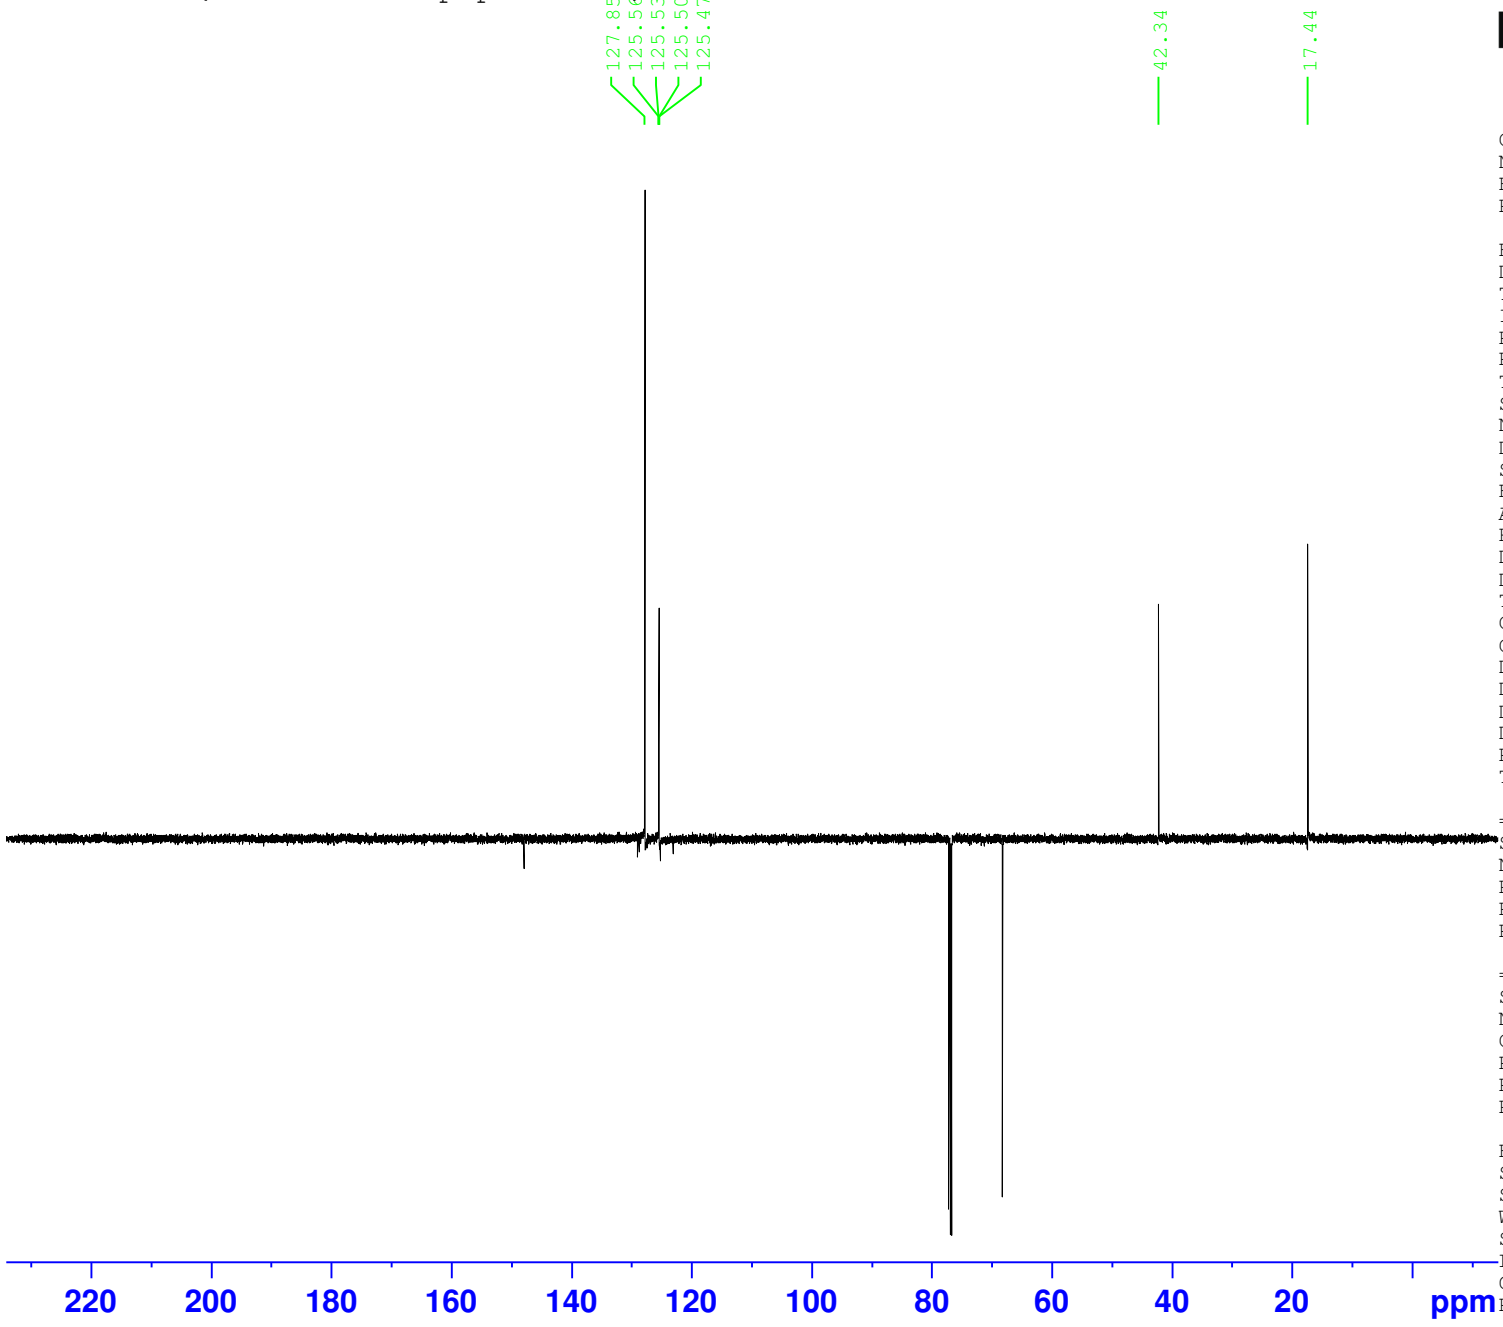


```
Current Data Parameters
NAME      500_AS860-2APT
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20251222
Time               20.22
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm CPPBBO BB
PULPROG             apt
TD                119044
SOLVENT             CDCl3
NS                    256
DS                      4
SWH            31250.000 Hz
FIDRES          0.262508 Hz
AQ             1.9047040 sec
RG                187.96
DW                16.000 usec
DE                19.98 usec
TE                297.8 K
CNST2         145.0000000
CNST11          1.0000000
D1             1.00000000 sec
D11            0.03000000 sec
D20            0.00689655 sec
D21            0.00050000 sec
P1                10.00 usec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1          125.7816793 MHz
NUC1                  13C
P0                10.00 usec
P2                20.00 usec
PLW1          64.19999695 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2          500.1720007 MHz
NUC2                  1H
CPDPRG[2          waltz64
PCPD2             80.00 usec
PLW2          15.39999962 W
PLW12          0.34650001 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF            125.7678465 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 1.00 Hz
GB        0
PC                 1.40
```