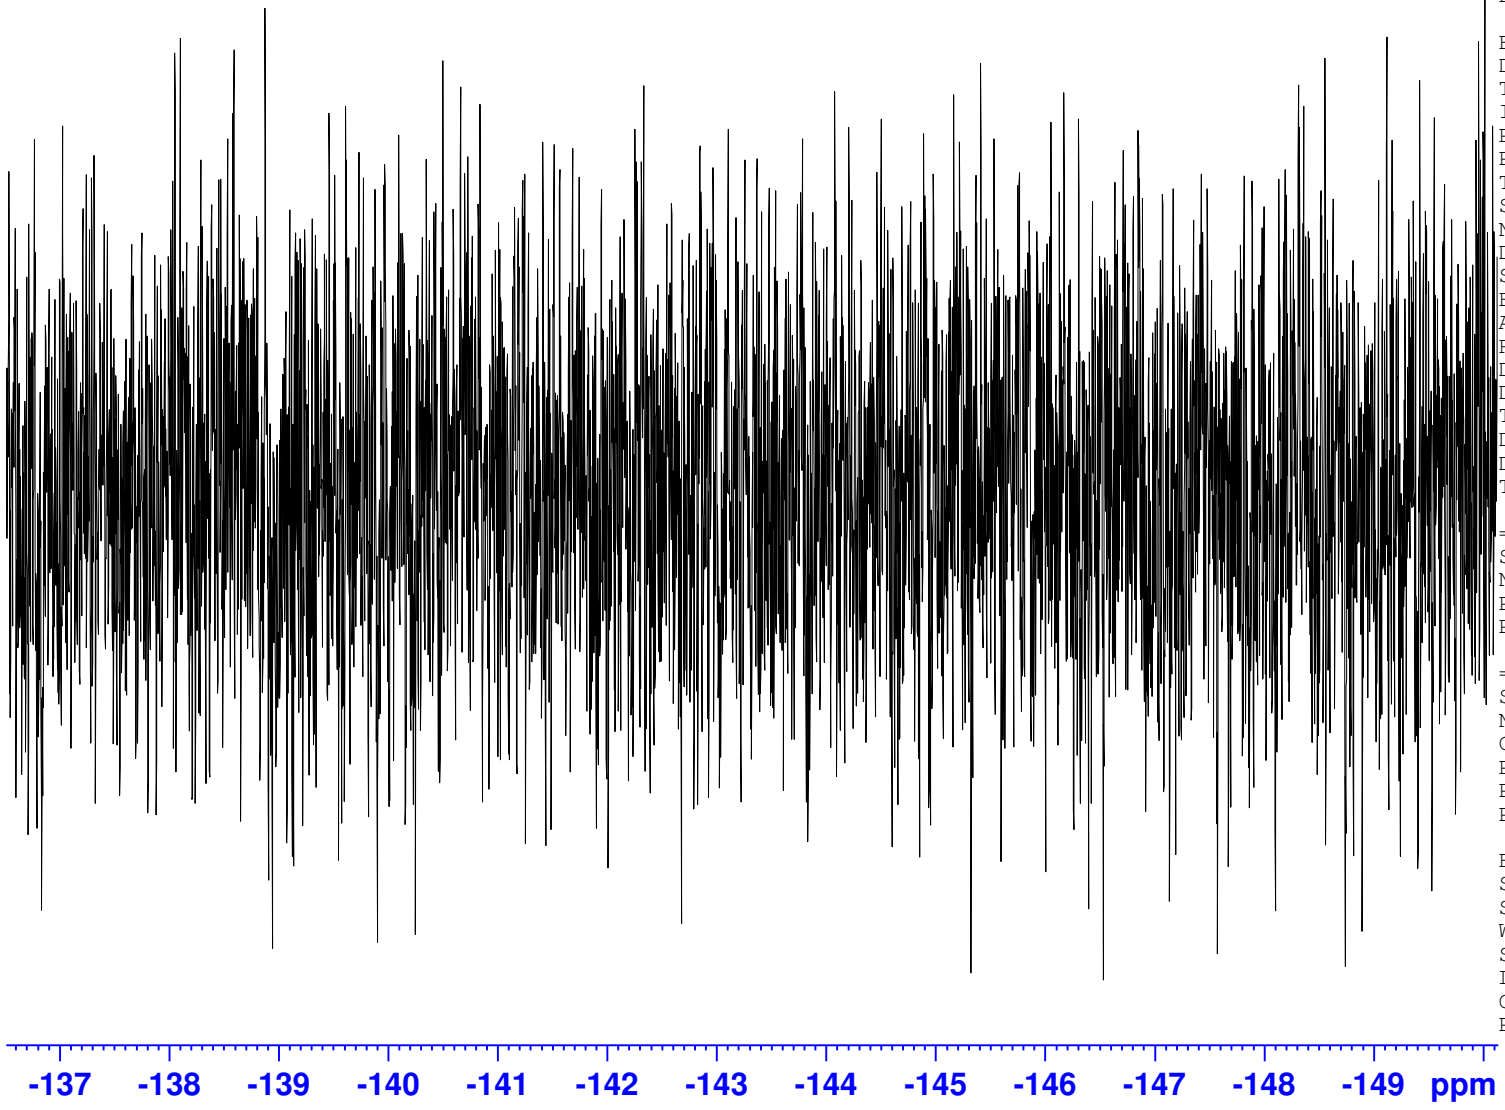



```
Current Data Parameters
NAME         400_AS887st
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20260817
Time               11.23
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG          zgig30
TD               261896
SOLVENT            CDCl3
NS                    16
DS                     4
SWH          150000.000 Hz
FIDRES         0.572746 Hz
AQ              0.8729867 sec
RG                208.99
DW                 3.333 usec
DE                 6.60 usec
TE                292.5 K
D1           1.00000000 sec
D11          0.03000000 sec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1         376.4607150 MHz
NUC1                 19F
P1                15.00 usec
PLW1         22.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2         400.1316006 MHz
NUC2                 1H
CPDPRG[2         waltz16
PCPD2             90.00 usec
PLW2         14.30000019 W
PLW12         0.18729000 W

F2 - Processing parameters
SI                262144
SF           376.4983662 MHz
WDW                  EM
SSB       0
LB                1.00 Hz
GB        0
PC                2.00
```