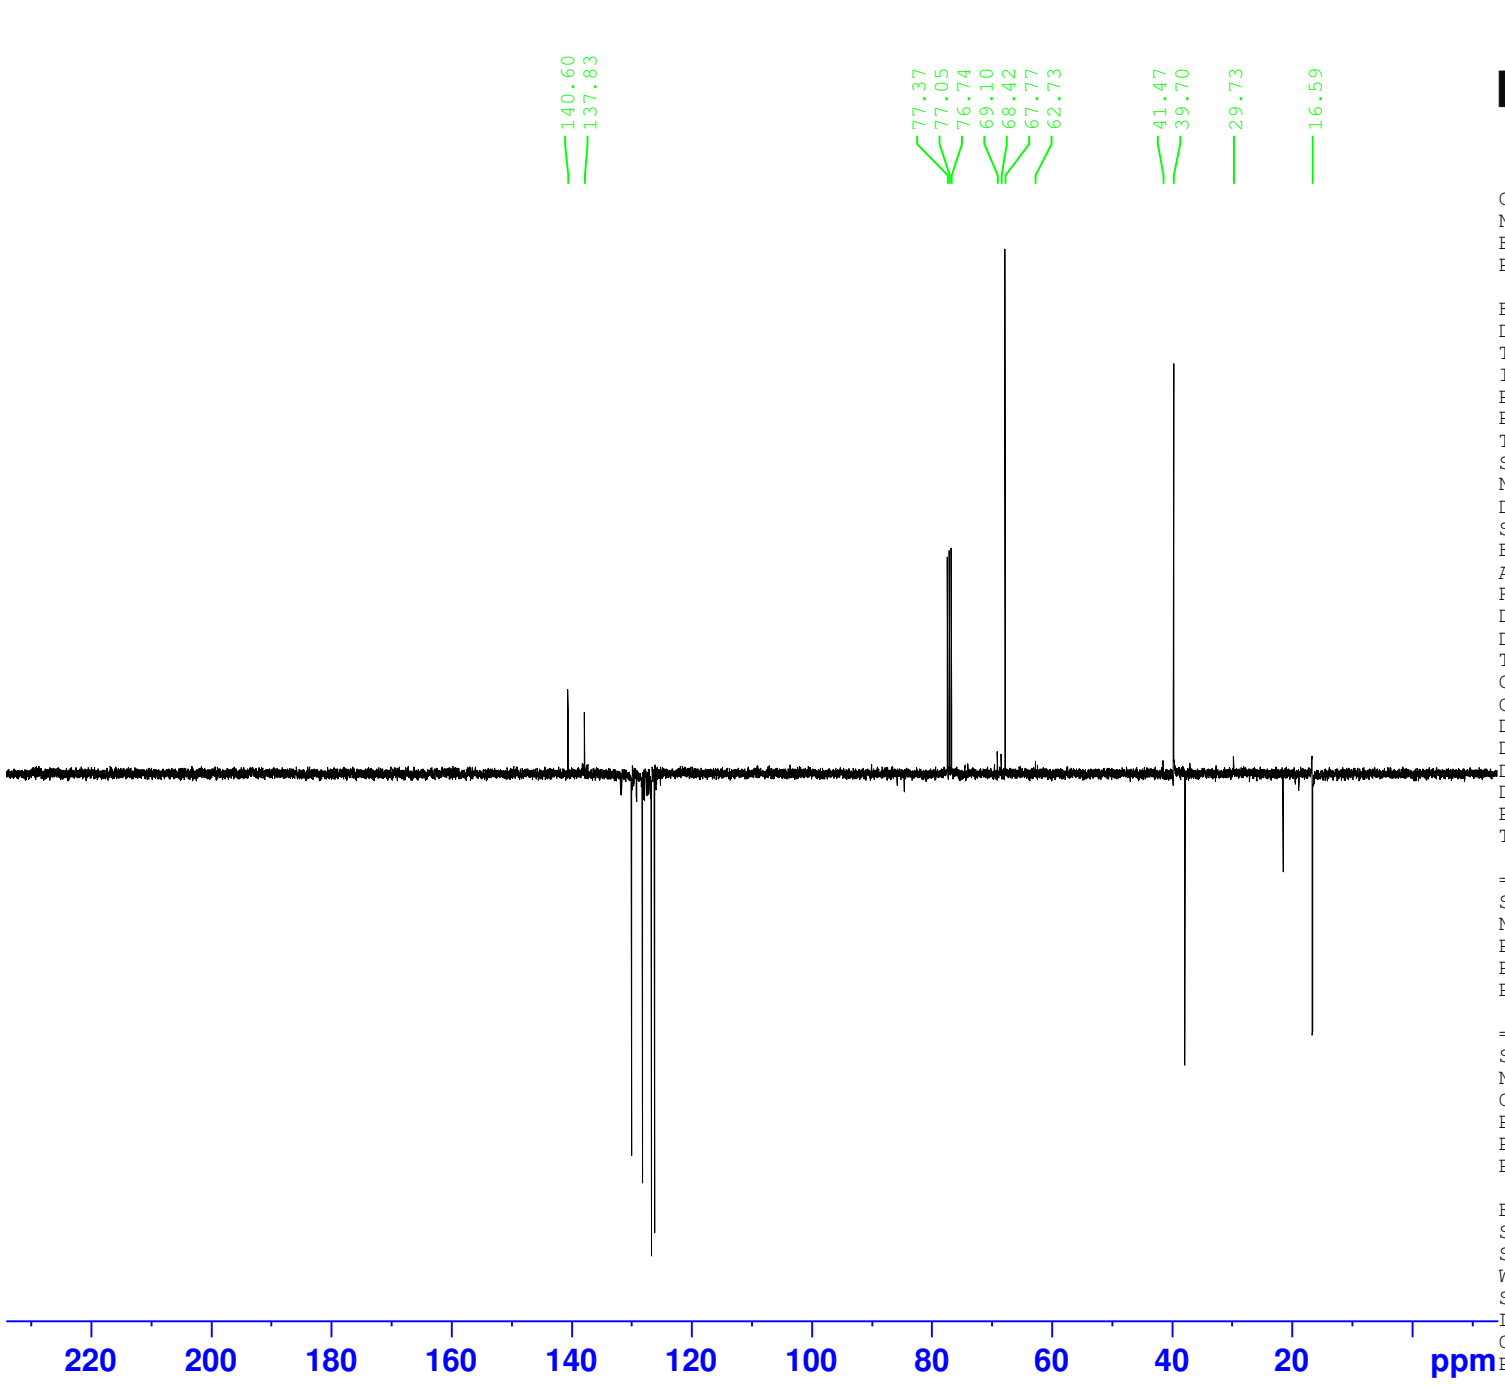


Current Data Parameters
NAME 400_AS930DMAPT
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20260811
Time 12.56
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm PABBO BB/
PULPROG apt
TD 119044
SOLVENT CDCl3
NS 512
DS 4
SWH 25000.000 Hz
FIDRES 0.210006 Hz
AQ 2.3808801 sec
RG 208.99
DW 20.000 usec
DE 9.73 usec
TE 293.4 K
CNST2 145.0000000
CNST11 1.0000000
D1 1.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
D20 0.00689655 sec
D21 0.00050000 sec
P1 10.00 usec
TD0 1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1 100.6238346 MHz
NUC1 13C
P0 10.00 usec
P2 20.00 usec
PLW1 59.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2 400.1316005 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz64
PCPD2 90.00 usec
PLW2 14.30000019 W
PLW12 0.18729000 W

F2 - Processing parameters
SI 131072
SF 100.6127685 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40