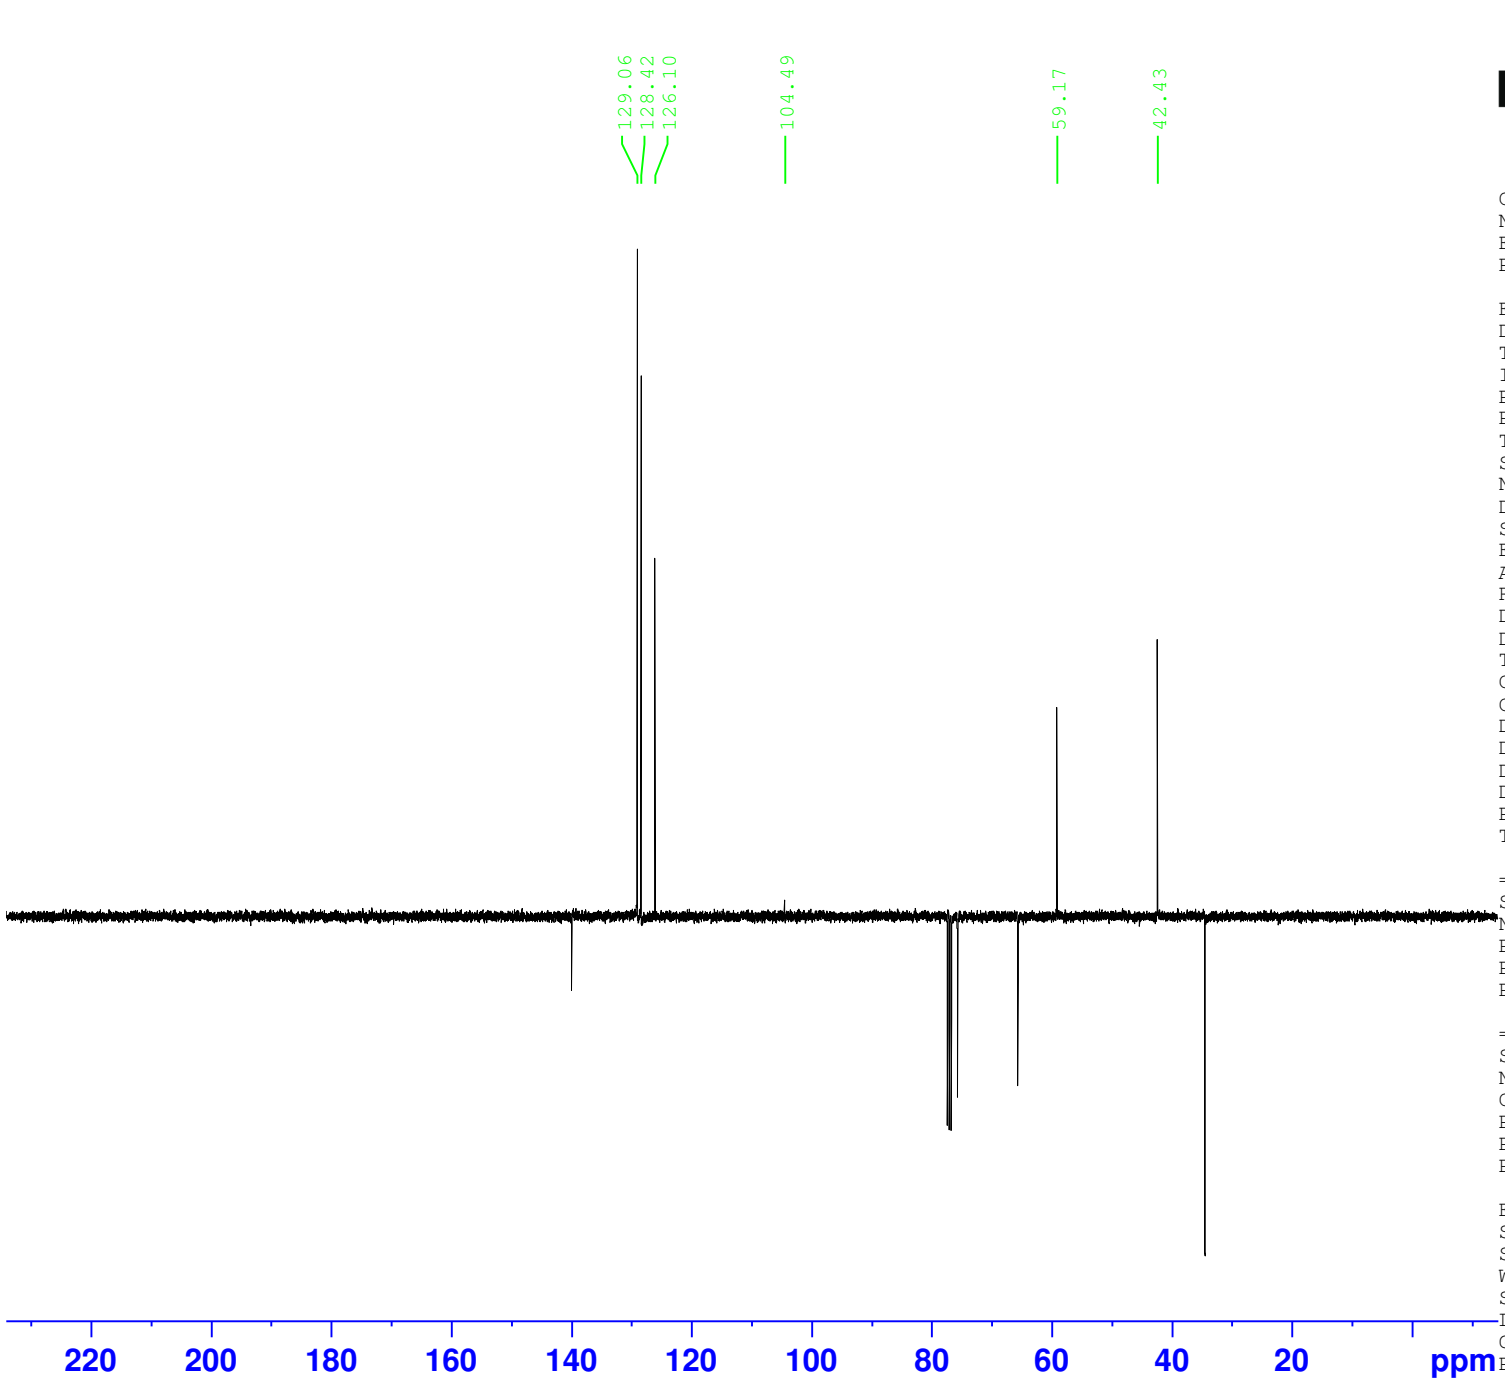



```
Current Data Parameters
NAME      400_AS963Bp2APT
EXPNO                  10
PROCNO                  1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20260611
Time               13.21
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG             apt
TD                119044
SOLVENT            CDCl3
NS                   512
DS                     4
SWH           25000.000 Hz
FIDRES         0.210006 Hz
AQ             2.3808801 sec
RG                208.99
DW                20.000 usec
DE                 9.73 usec
TE                293.4 K
CNST2        145.0000000
CNST11         1.0000000
D1           1.00000000 sec
D11          0.03000000 sec
D20          0.00689655 sec
D21          0.00050000 sec
P1                10.00 usec
TD0                   1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1         100.6238346 MHz
NUC1                 13C
P0                10.00 usec
P2                20.00 usec
PLW1         59.00000000 W

======== CHANNEL f2 ========
SFO2         400.1316005 MHz
NUC2                 1H
CPDPRG[2          waltz64
PCPD2             90.00 usec
PLW2         14.30000019 W
PLW12         0.18729000 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF           100.6127685 MHz
WDW                  EM
SSB       0
LB                 1.00 Hz
GB        0
PC                 1.40
```