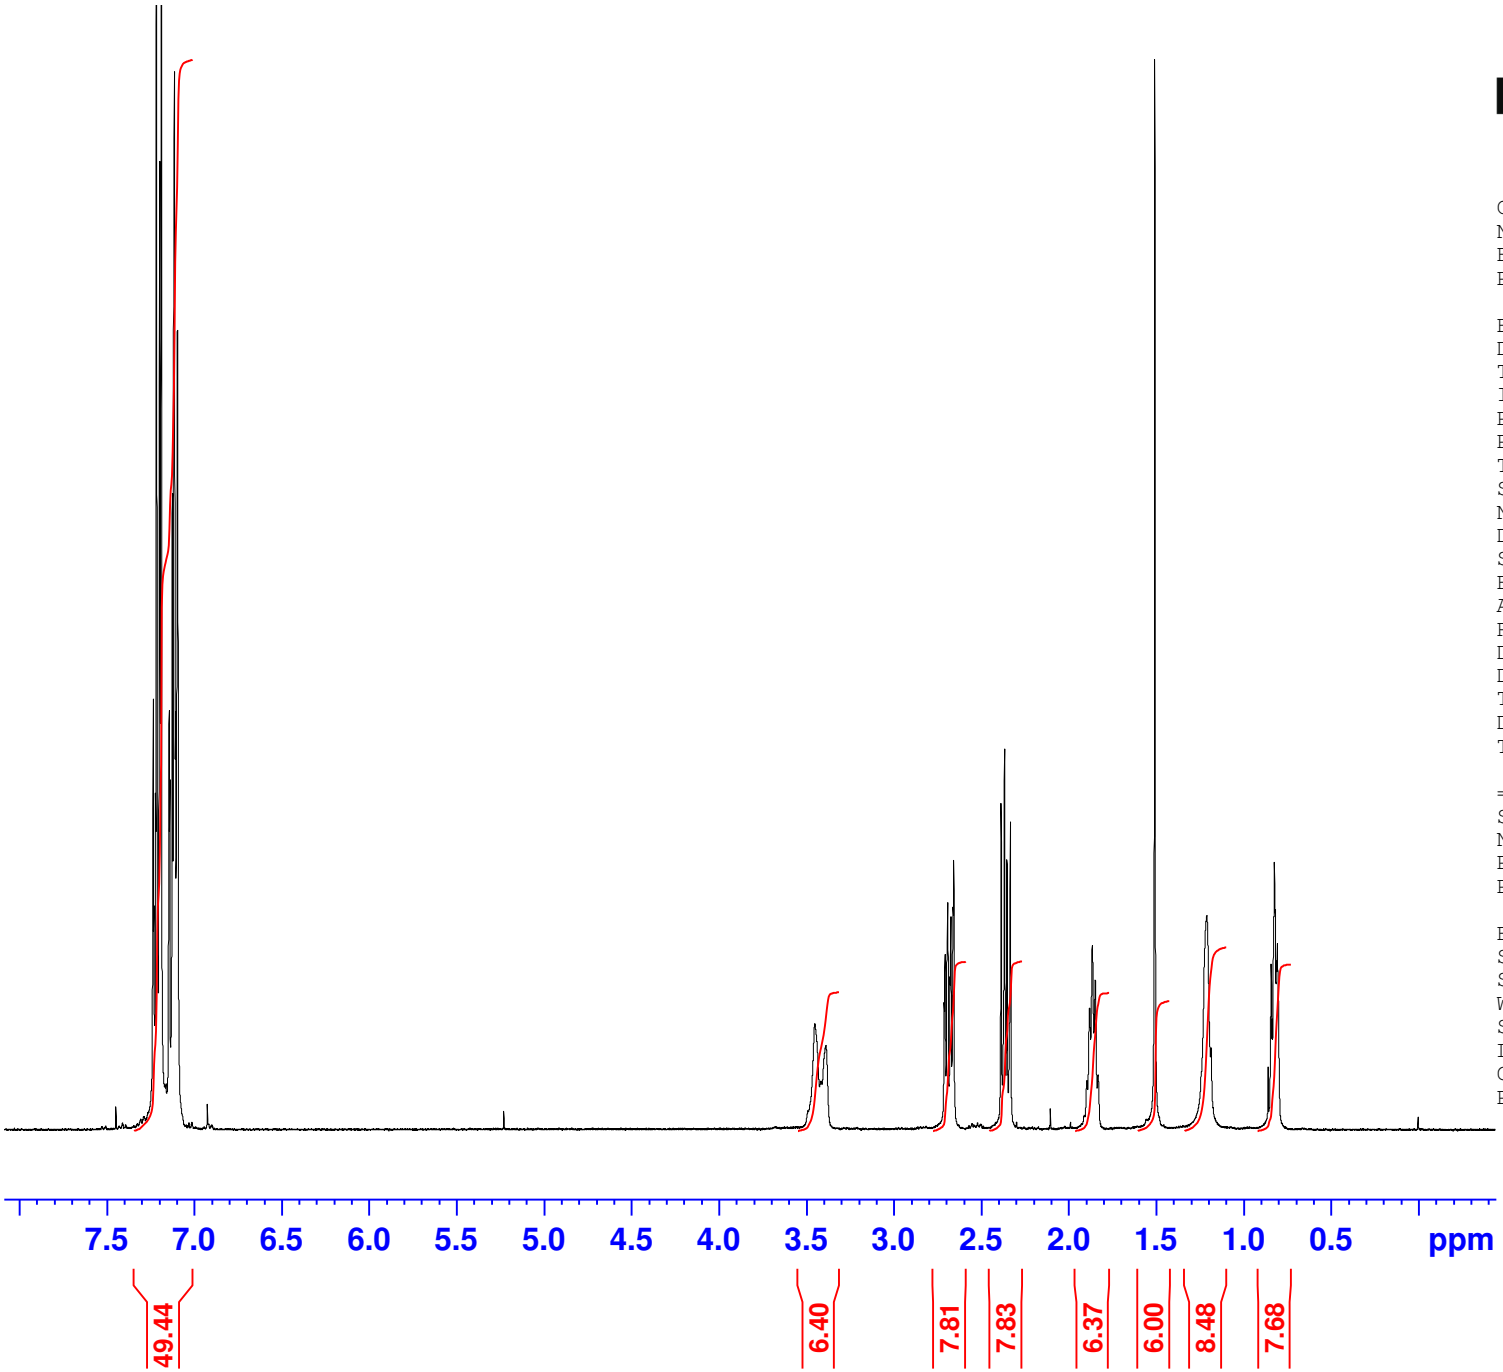



```
Current Data Parameters
NAME      400_AS880P2H1
EXPNO                20
PROCNO                1

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20251222
Time              19.19
INSTRUM           spect
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG            zg30
TD               131072
SOLVENT           CDCl3
NS                   16
DS                    0
SWH            6402.049 Hz
FIDRES        0.048844 Hz
AQ           10.2367229 sec
RG               117.64
DW               78.100 usec
DE                13.89 usec
TE                292.5 K
D1           1.00000000 sec
TD0                   1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        400.1328009 MHz
NUC1                1H
P1                10.00 usec
PLW1        14.30000019 W

F2 - Processing parameters
SI               131072
SF          400.1300378 MHz
WDW                 EM
SSB      0
LB                0.20 Hz
GB       0
PC                1.00
```