
Proton.icon CDCl3 {C:\Bruker\TopSpin3.2.7} LCM 40

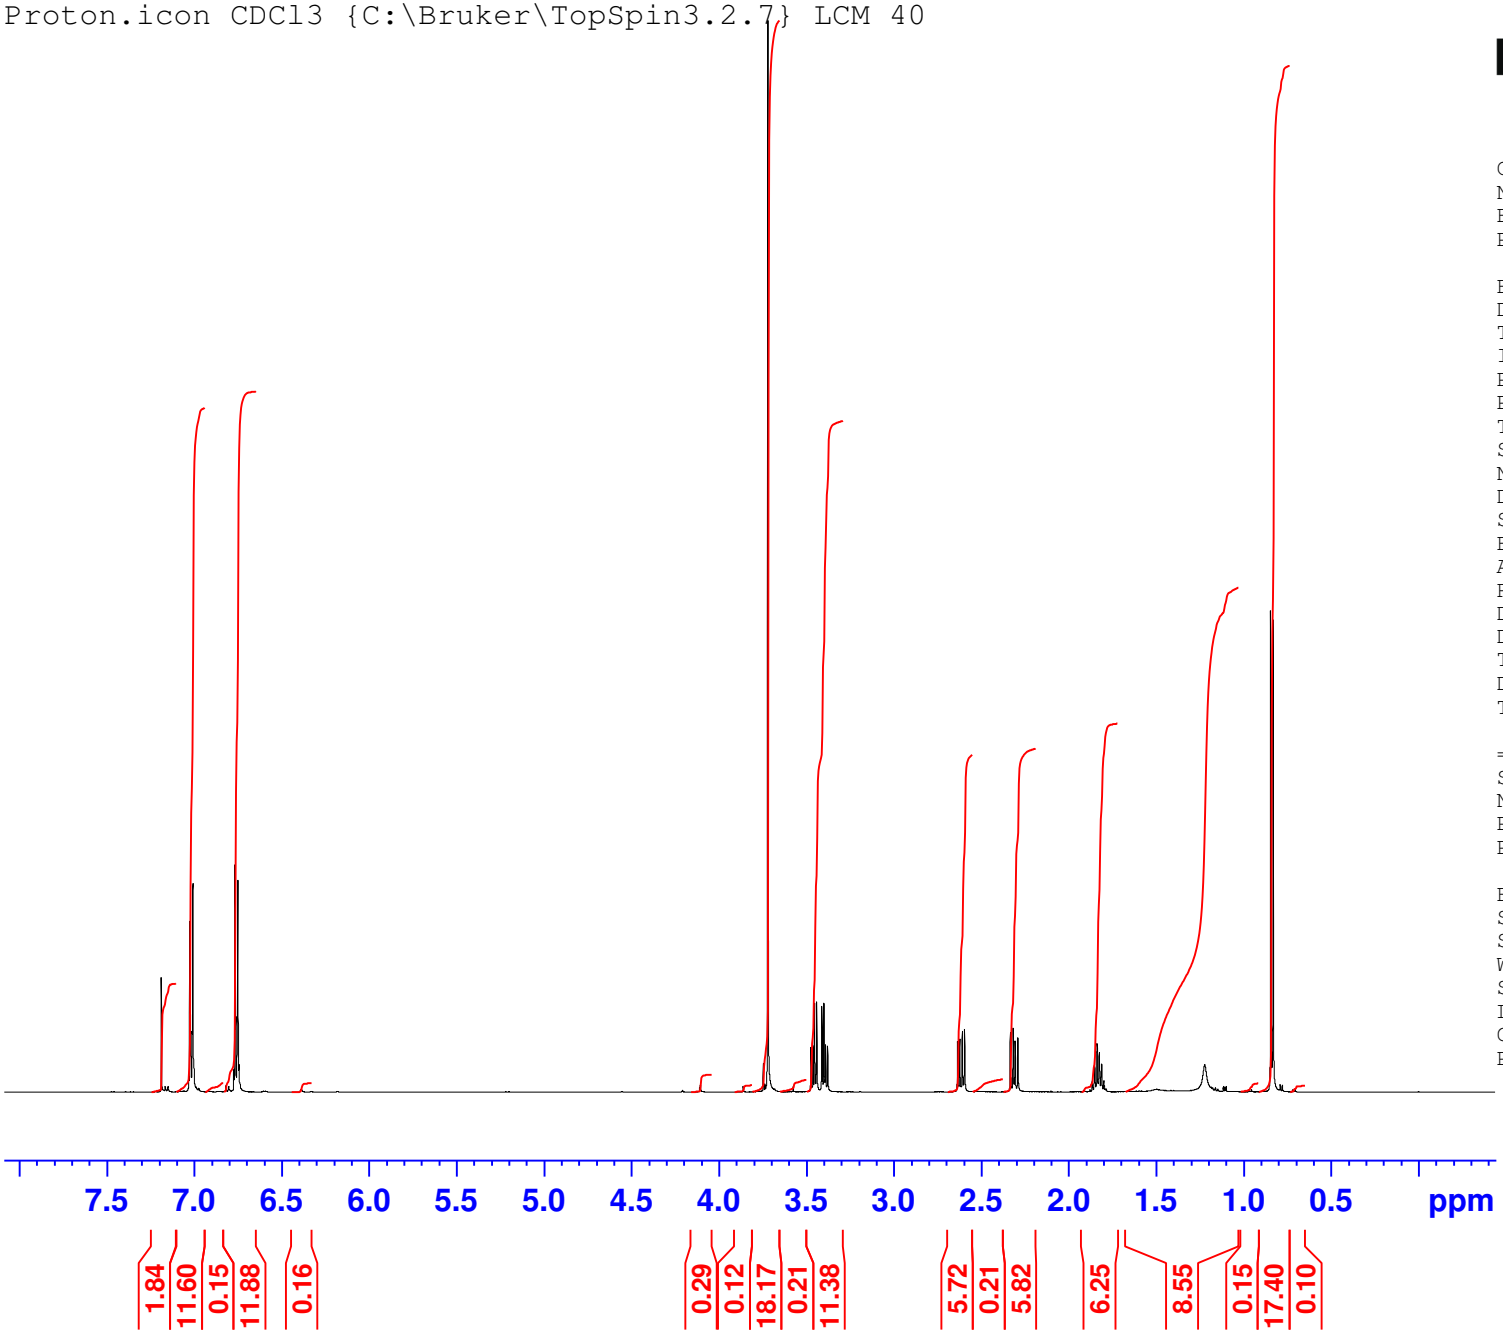

Current Data Parameters
NAME 500_AS706H1
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20230615
Time 14.26
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm CPPBBO BB
PULPROG zg30
TD 131072
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 0
SWH 8000.000 Hz
FIDRES 0.061035 Hz
AQ 8.1920004 sec
RG 187.96
DW 62.500 usec
DE 41.60 usec
TE 296.2 K
D1 0.10000000 sec
TD0 1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1 500.1735012 MHz
NUC1 1H
P1 12.00 usec
PLW1 15.39999962 W

F2 - Processing parameters
SI 131072
SF 500.1700477 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.10 Hz
GB 0
PC 1.00