
19F_wide_new CDCl3 {C:\Bruker\TopSpin3.2.7} LCM 9

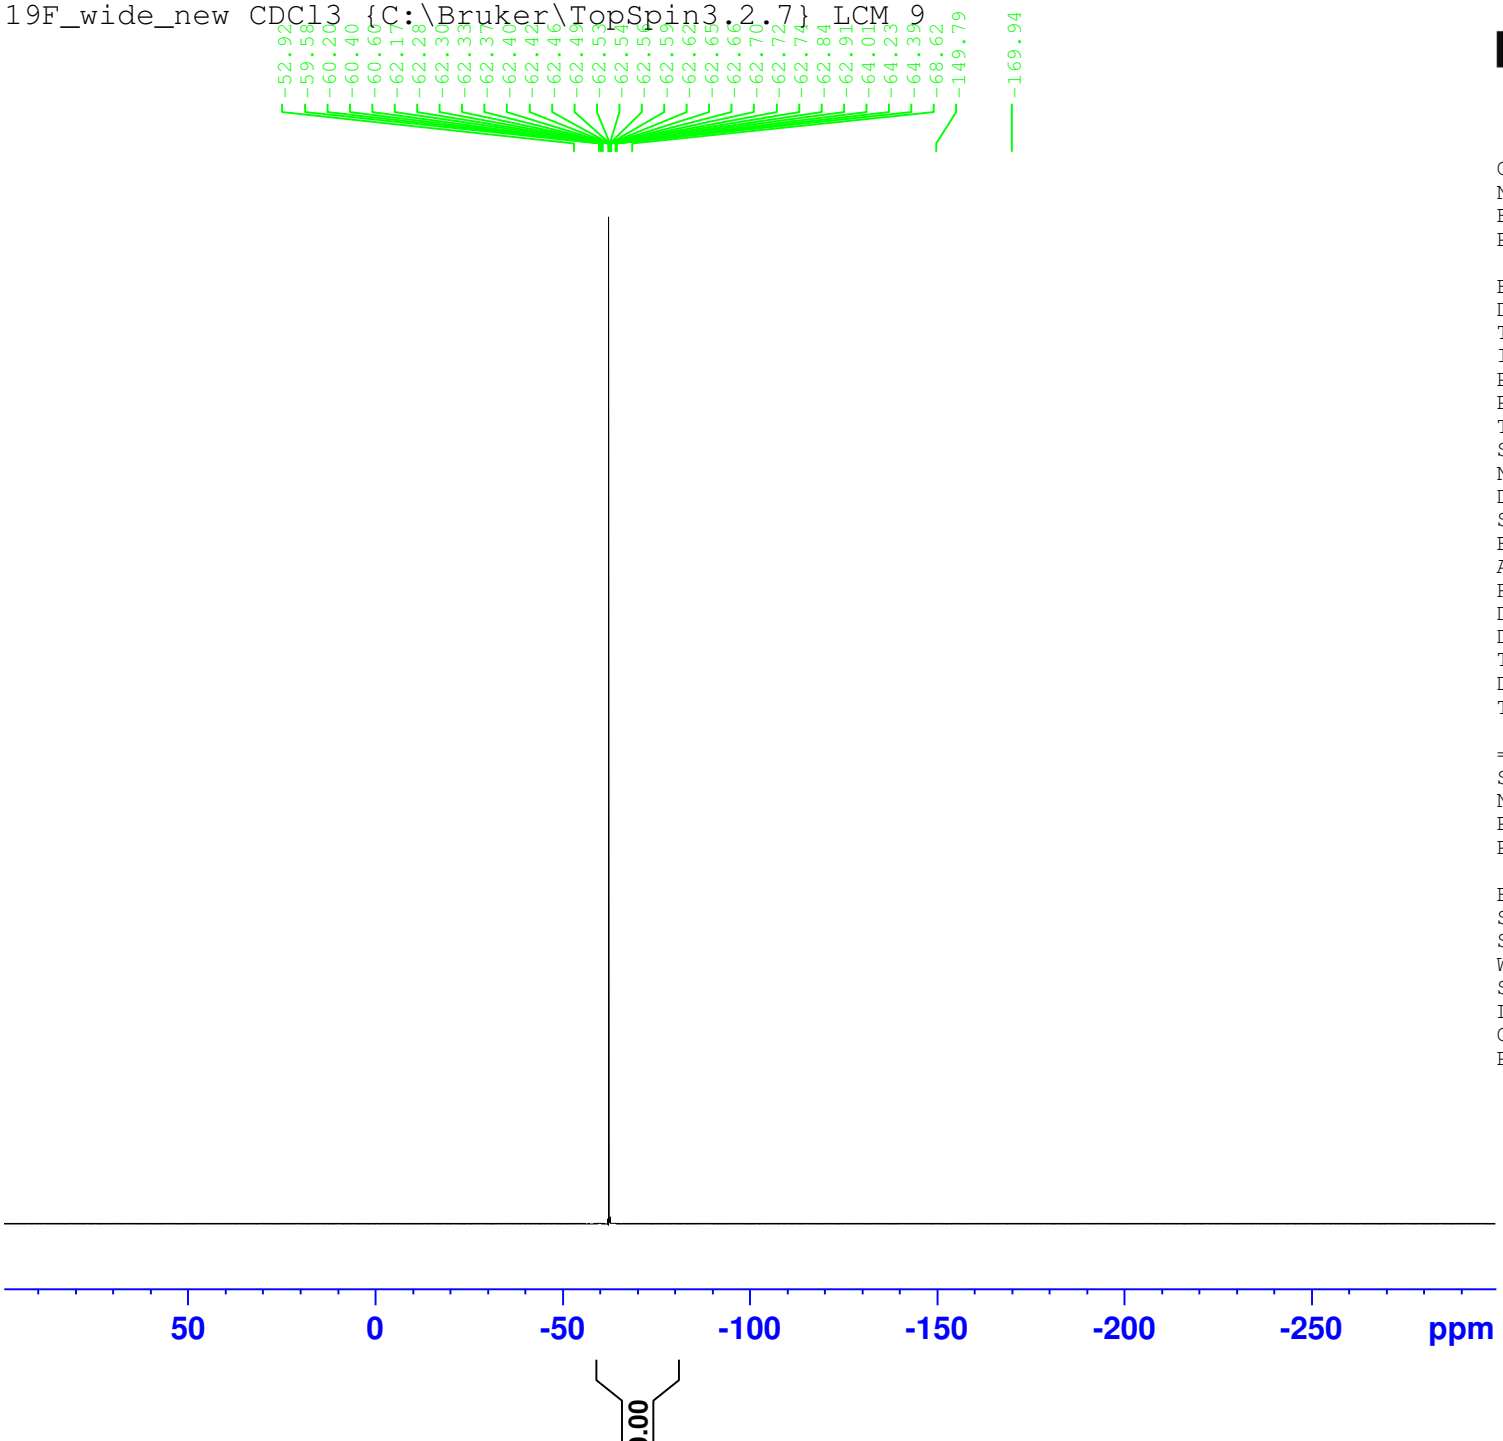

Current Data Parameters
NAME 500_AS903CP1F19
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20260122
Time 13.56
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm CPPBBO BB
PULPROG zgflqn
TD 130840
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 4
SWH 187500.000 Hz
FIDRES 1.433048 Hz
AQ 0.3489067 sec
RG 15.37
DW 2.667 usec
DE 18.00 usec
TE 297.8 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1 470.5829518 MHz
NUC1 19F
P1 15.00 usec
PLW1 10.00000000 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 470.6300148 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00