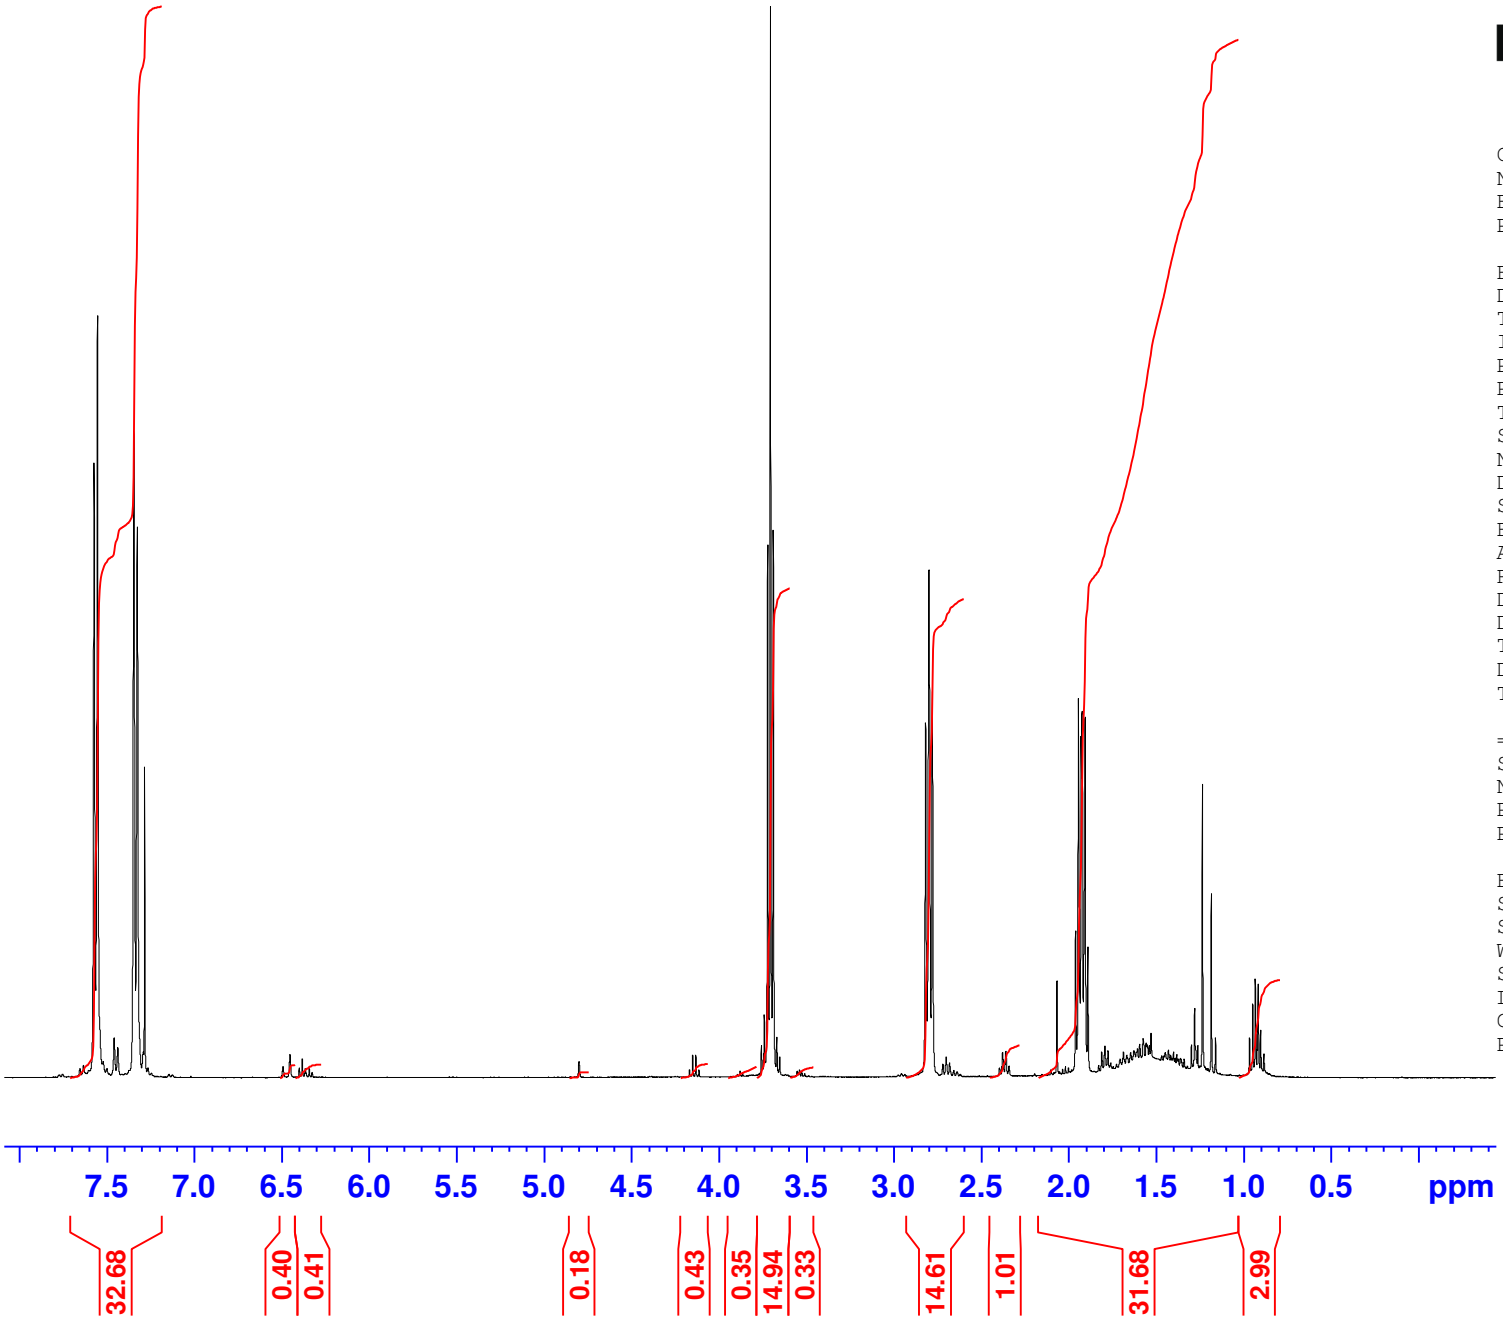


BRUKER

```
Current Data Parameters
NAME      400_AS903CP1H1
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20260121
Time               18.30
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG             zg30
TD                131072
SOLVENT             CDCl3
NS                    16
DS                     0
SWH             6402.049 Hz
FIDRES          0.048844 Hz
AQ            10.2367229 sec
RG                 82.48
DW                78.100 usec
DE                13.89 usec
TE                292.6 K
D1            1.00000000 sec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1         400.1328009 MHz
NUC1                   1H
P1                 10.00 usec
PLW1         14.30000019 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF           400.1300000 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 0.20 Hz
GB        0
PC                 1.00
```