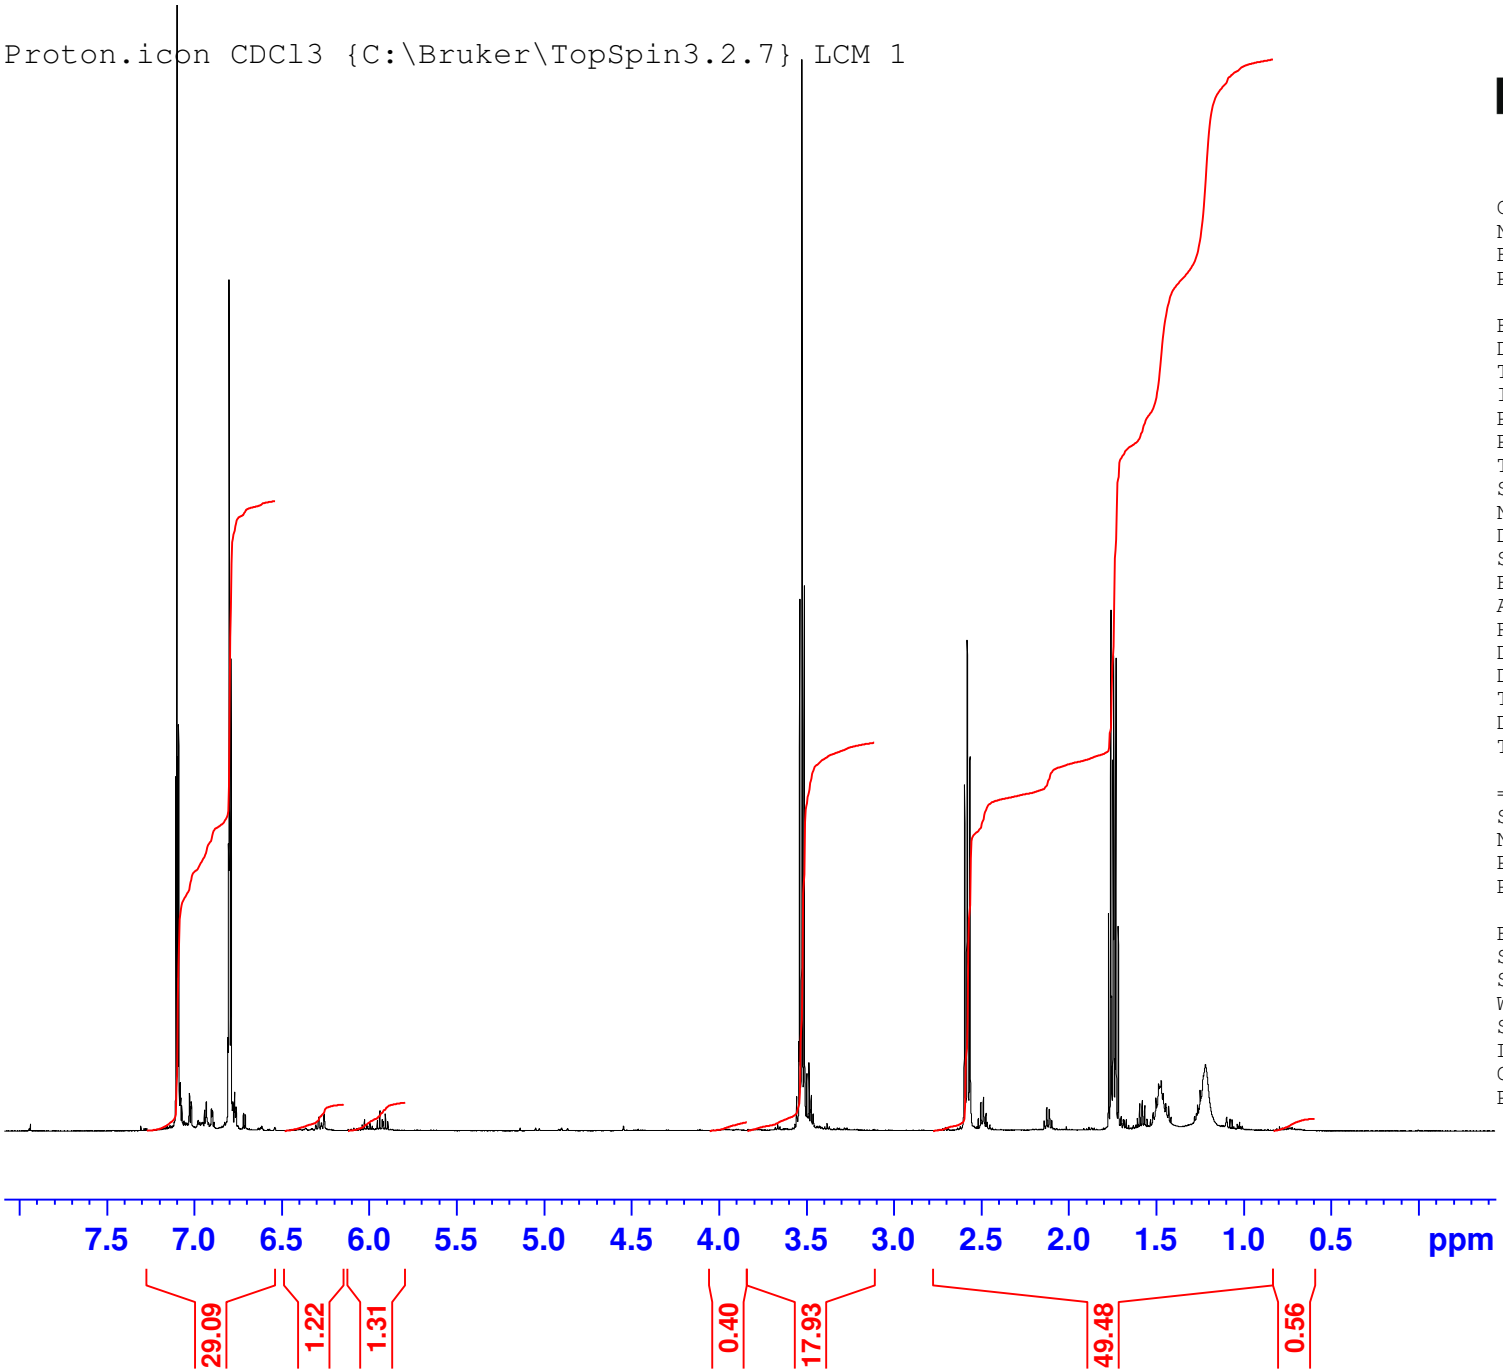


BRUKER

```
Current Data Parameters
NAME        500_AS924BH1
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20260315
Time               12.03
INSTRUM            spect
PROBHD   5 mm CPPBBO BB
PULPROG             zg30
TD                131072
SOLVENT             CDCl3
NS                     16
DS                      0
SWH             8000.000 Hz
FIDRES          0.061035 Hz
AQ              8.1920004 sec
RG                 137.46
DW                 62.500 usec
DE                 41.60 usec
TE                 295.1 K
D1            0.10000000 sec
TD0                    1

======== CHANNEL f1 ========
SFO1         500.1735012 MHz
NUC1                   1H
P1                 12.00 usec
PLW1         15.39999962 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF           500.1700921 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                 0.10 Hz
GB        0
PC                 1.00
```