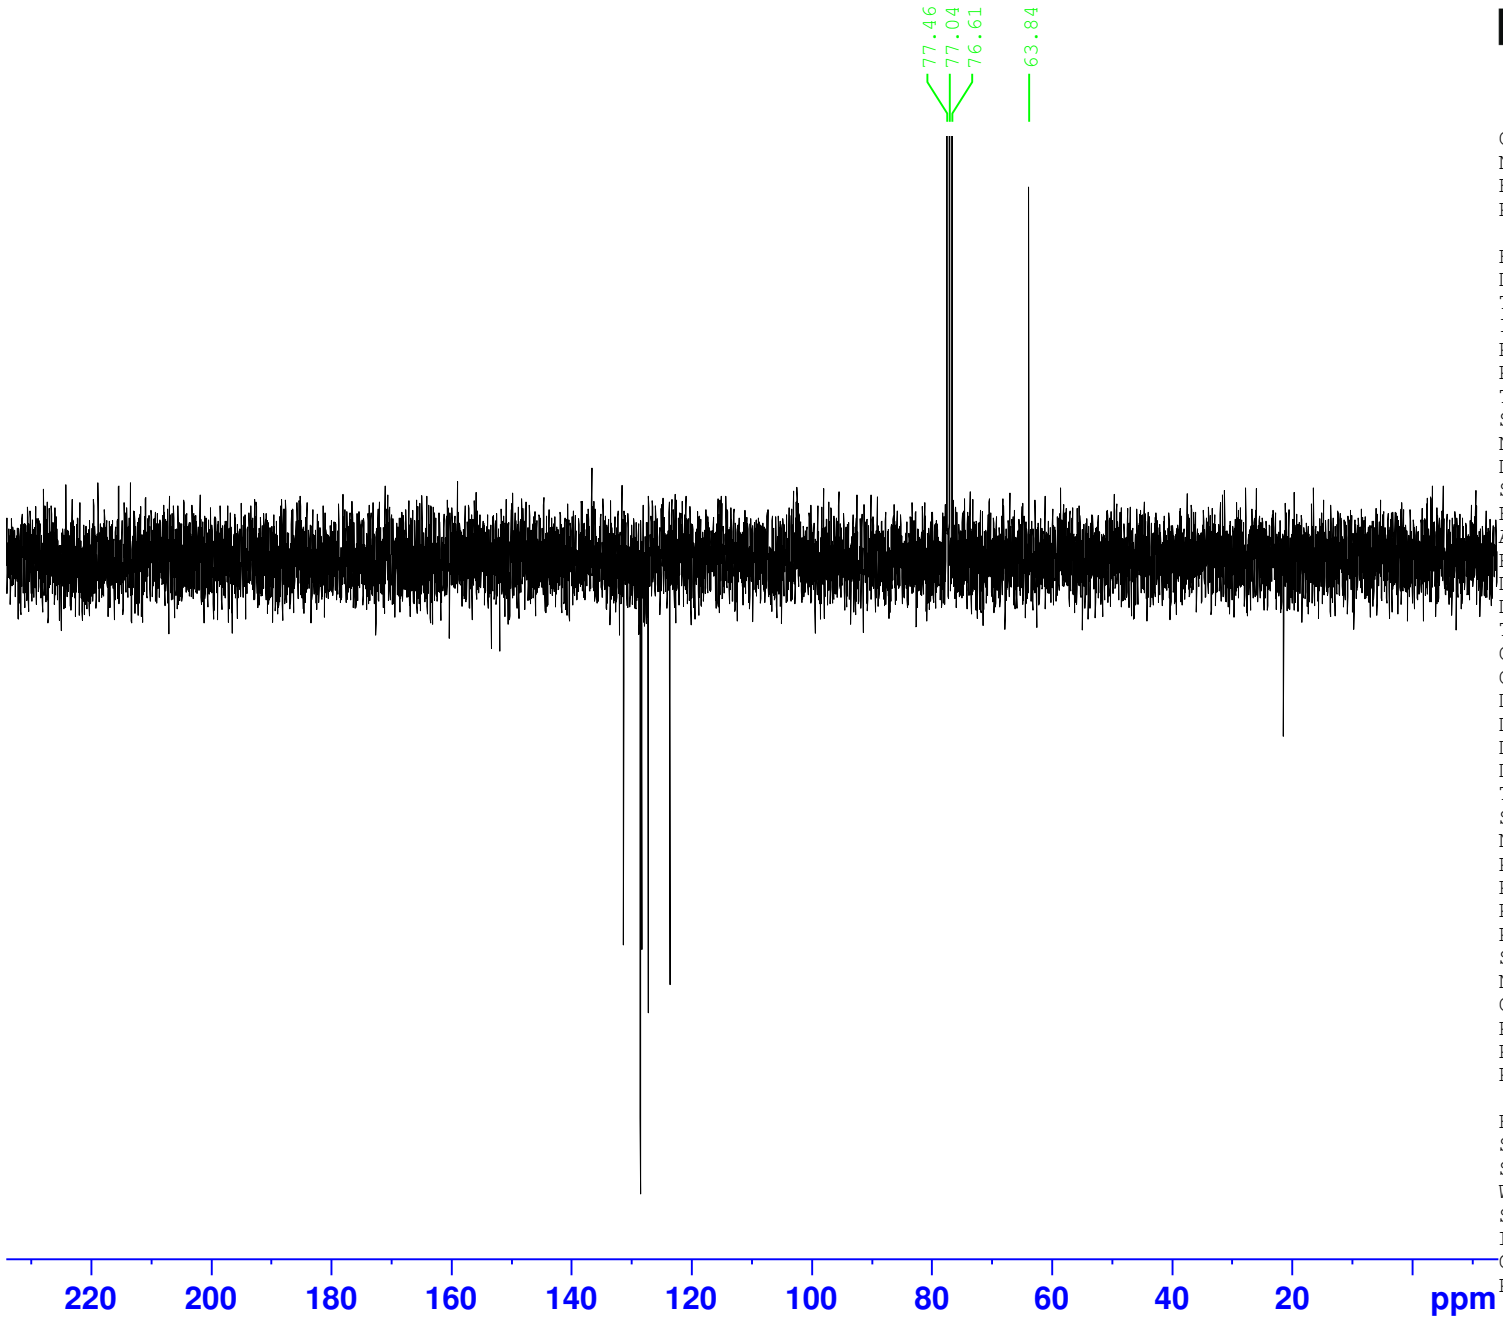


Current Data Parameters
NAME 300_AS930BAPT
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20260709
Time 14.20 h
INSTRUM spect
PROBHD Z111650_0118 (
PULPROG apt
TD 119044
SOLVENT CDCl3
NS 256
DS 4
SWH 18750.000 Hz
FIDRES 0.315010 Hz
AQ 3.1745067 sec
RG 2050
DW 26.667 usec
DE 6.88 usec
TE 295.0 K
CNST2 145.0000000
CNST11 1.0000000
D1 1.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
D20 0.00689655 sec
D21 0.00050000 sec
TD0 1
SFO1 75.4760490 MHz
NUC1 13C
P0 15.00 usec
P1 15.00 usec
P2 30.00 usec
PLW1 27.00000000 W
SFO2 300.1312005 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz64
PCPD2 90.00 usec
PLW2 10.00000000 W
PLW12 0.27778000 W

F2 - Processing parameters
SI 131072
SF 75.4677485 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40