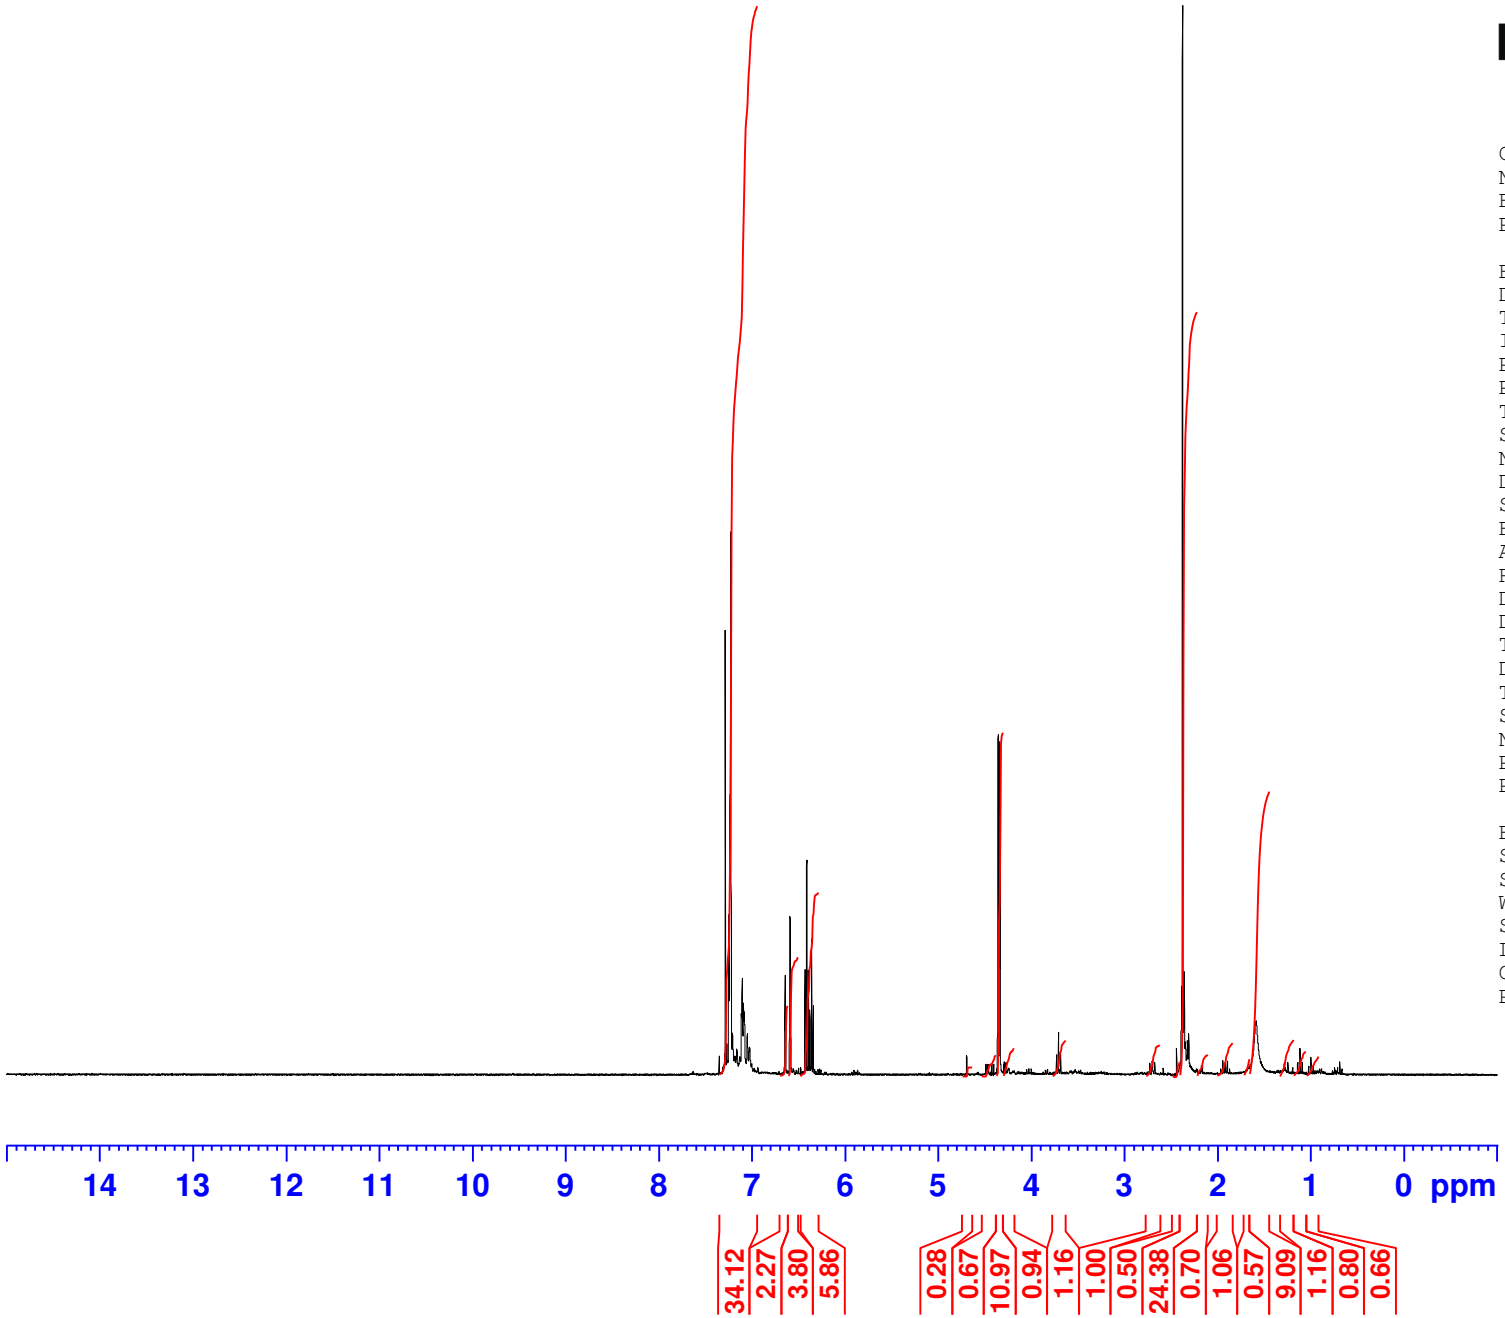



```
Current Data Parameters
NAME        300_AS930BH1
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20260709
Time               13.11 h
INSTRUM            spect
PROBHD   Z111650_0118 (
PULPROG             zg30
TD                 65536
SOLVENT            CDCl3
NS                    16
DS                     0
SWH             4807.692 Hz
FIDRES          0.146719 Hz
AQ              6.8157439 sec
RG                232.27
DW               104.000 usec
DE                 8.50 usec
TE                293.5 K
D1             1.00000000 sec
TD0                    1
SFO1          300.1321009 MHz
NUC1                  1H
P1                15.00 usec
PLW1          10.00000000 W

F2 - Processing parameters
SI                 65536
SF          300.1300000 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                0.10 Hz
GB        0
PC                1.00
```